


2. 写真資料


QUATEST-3 引張り試験機




QUATEST-3 電気計測用抵抗器標準機

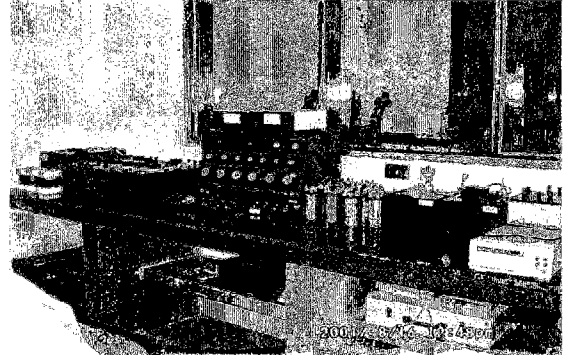


QUATEST-3標準機設置室温度・湿度計測記録

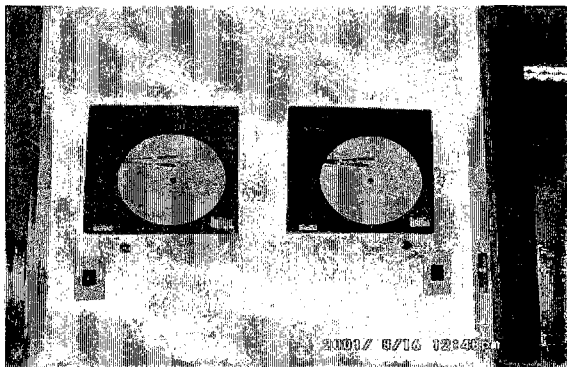


QUATEST-3 圧力標準機 (箱に格納)

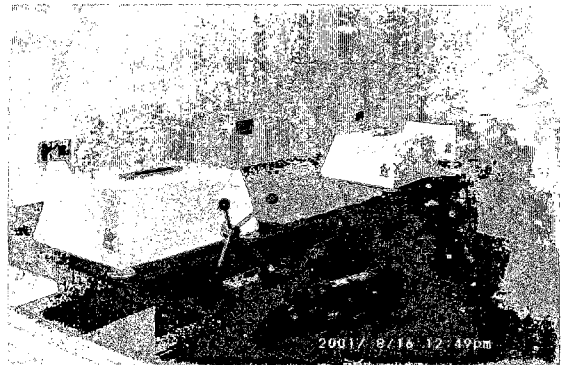

QUATEST-3 長さ標準機

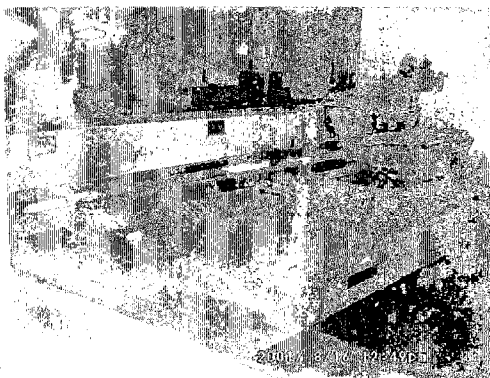


QUATEST-3 重さ標準機 (Secondary Standard)

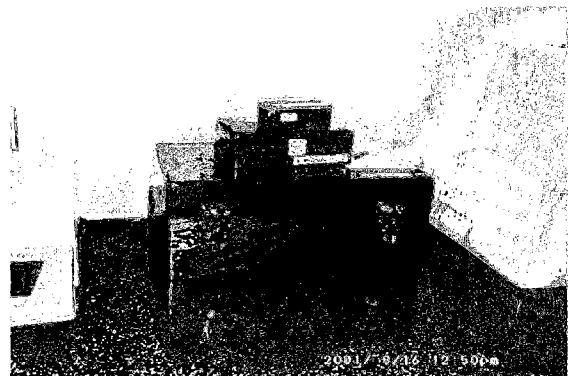



QUATEST-3 重さ標準機 (Working Standard)

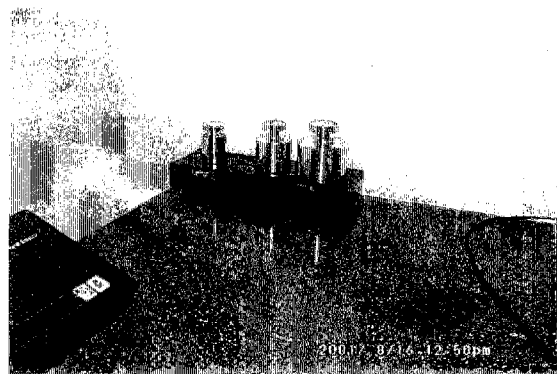

QUATEST-3 バランサー (ガラス箱に格納)




QUATEST-3 軽量バルンサー




QUATEST-3 容積標準機



QUATEST-3 温度計標準機

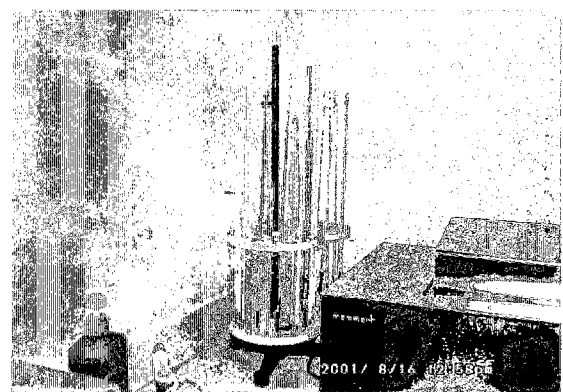


QUATEST-3 温度計校正試験

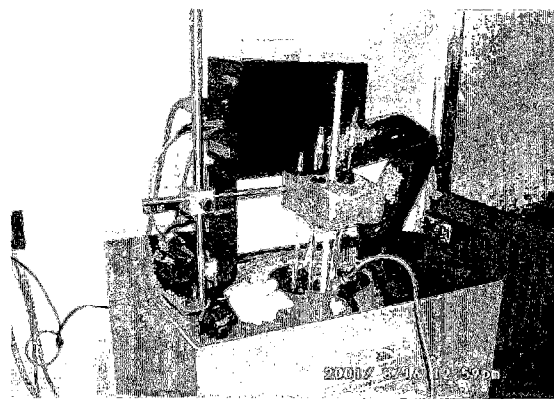



QUATEST-3 ロードセル校正用ロードリング

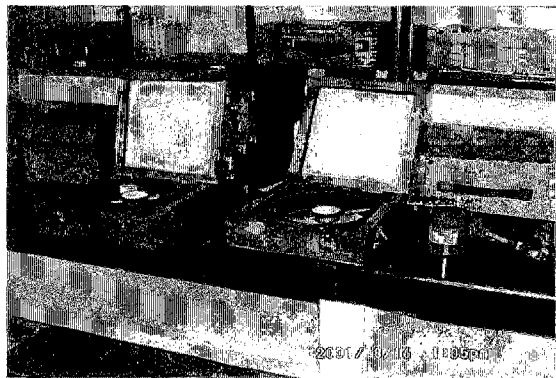

QUATEST-3 所長 Mr. Dinh Van Tru (Vice director) と Ms. Huong






VMI, 各種重量標準機 (Primary Standard)




VMI, 重量標準機 (Primary Standard)

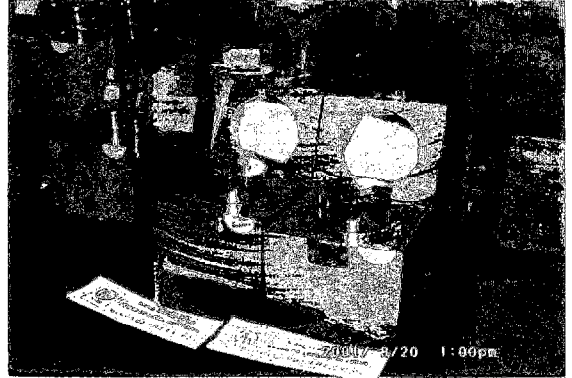

VMI, 重量標準機とバランサー (Working Standard)




VMI, 長さ標準機

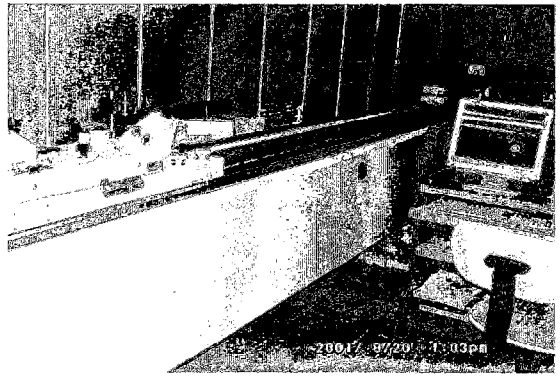

VMI, 電流・電圧測定機



VMI, 電気抵抗標準機

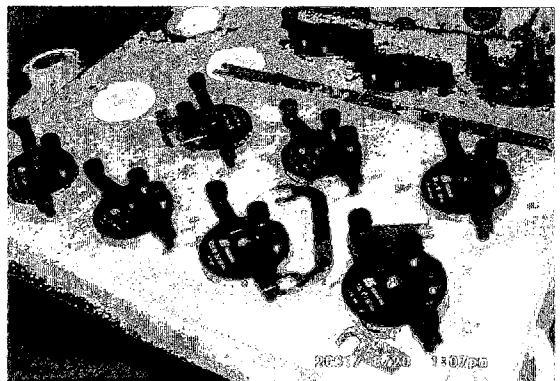







VMI, 電気抵抗標準機




VMI, 温度計校正測定機

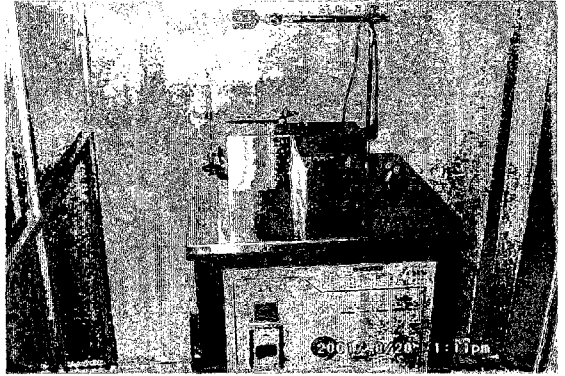


VMI, 電気測定標準機

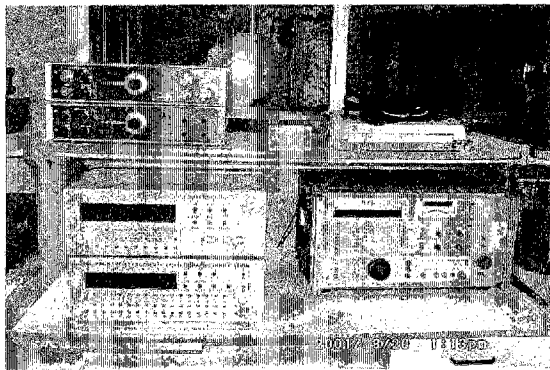


VMI, 電気測定標準機

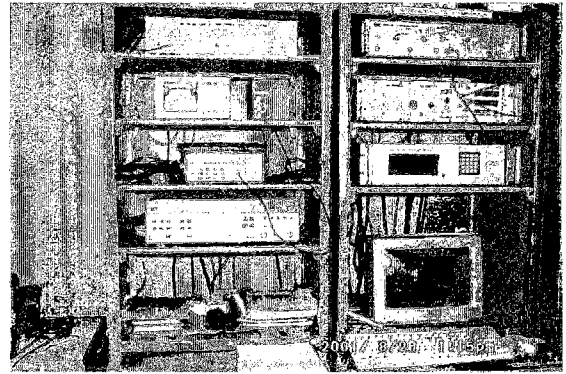

VMI, グリニッチ標準時間

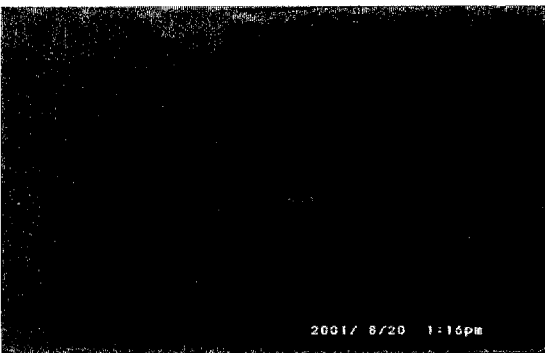

VMI, 力の標準機

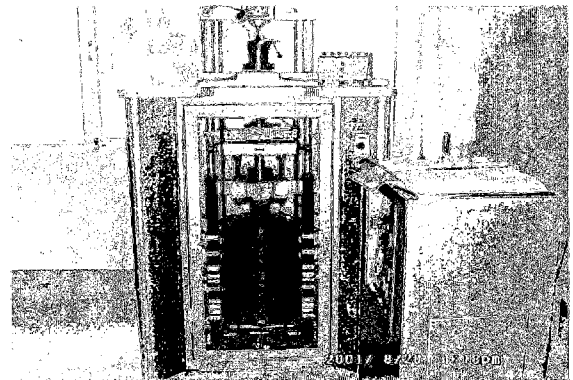





VMI、力の標準機




VMI、圧力標準機

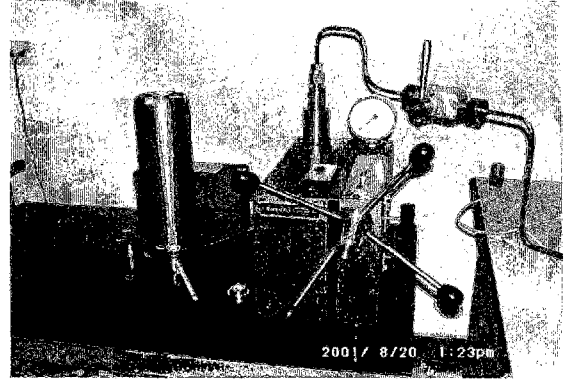


VMI、ガス分析機

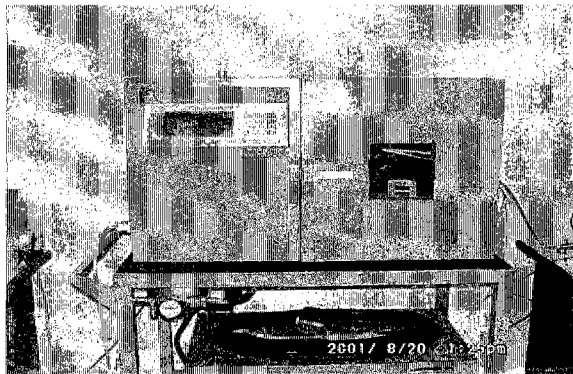


VMI、計量標準機設置室の温度・湿度測定記録

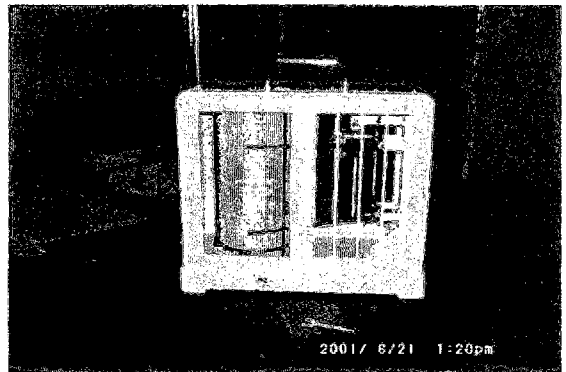

VMI、力測定機

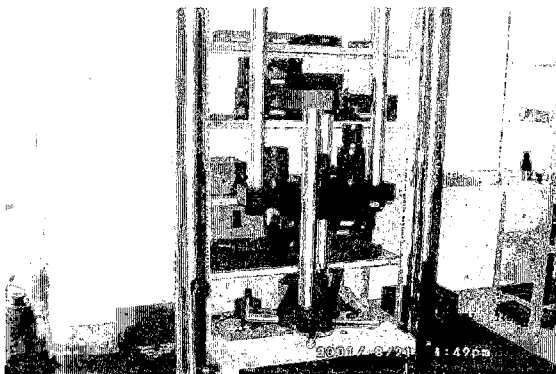


VMI、圧力標準測定機

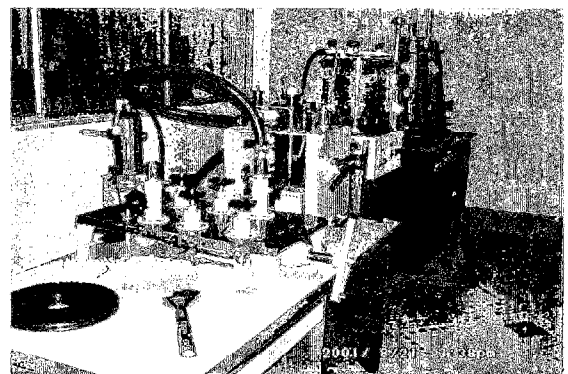





VMI, 電気計測室

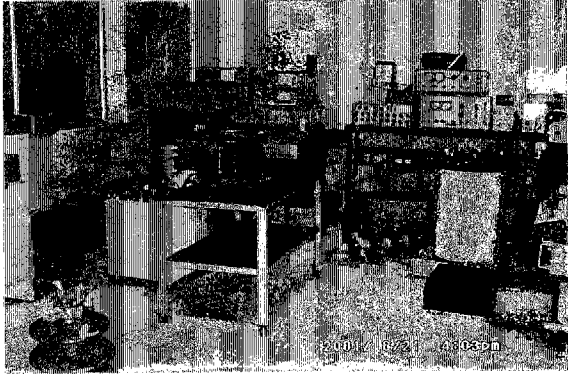

VMI, 容積標準機

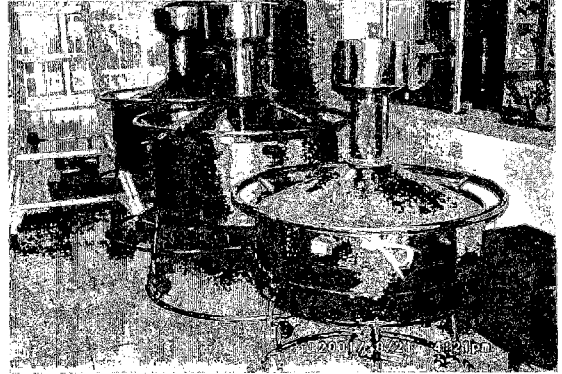

VMI, 計量標準について矢野課長補佐の講演

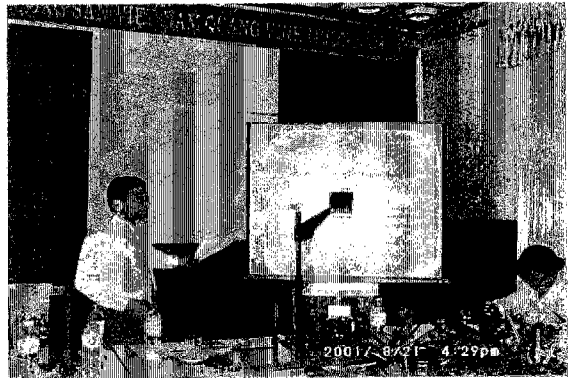


VMI, Mr. Ngo Huy Van, Director






カンボジアMOI, 重量標準機(北朝鮮寄贈)

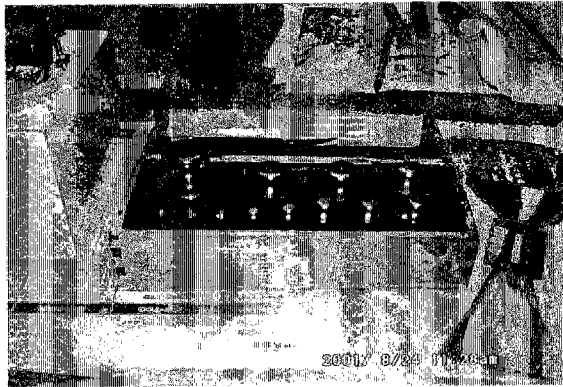


カンボジアMOI, 重量バランサー (自作)




カンボジアMOI, 容積標準機

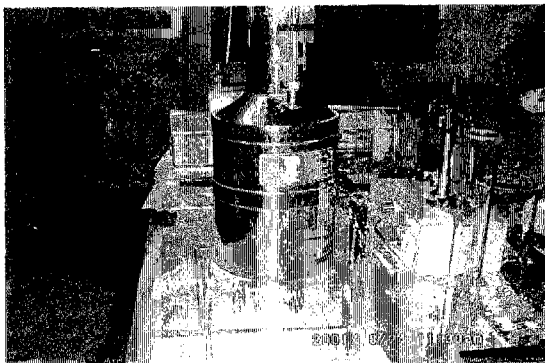


カンボジアMOI, 容積標準機(メスシリンダ)

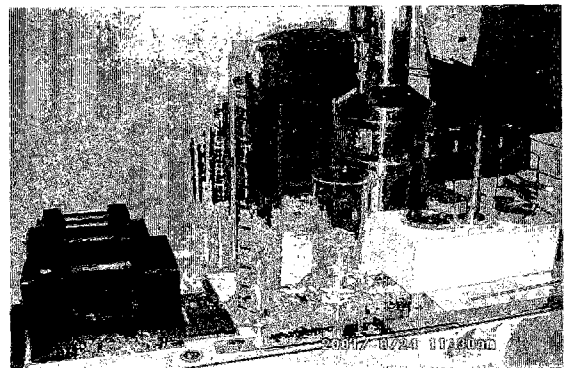

カンボジアMOI, 20kg, 10kg, 5kgの各標準機

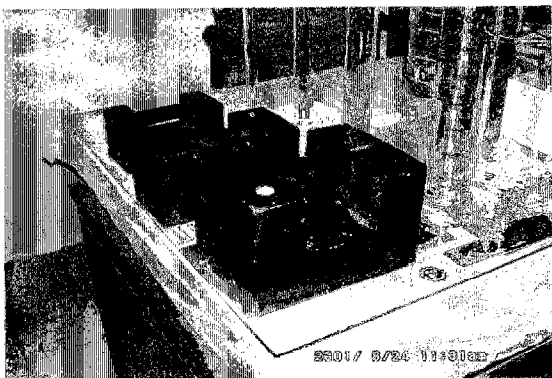

カンボジアMOI, 容積標準機(自作)

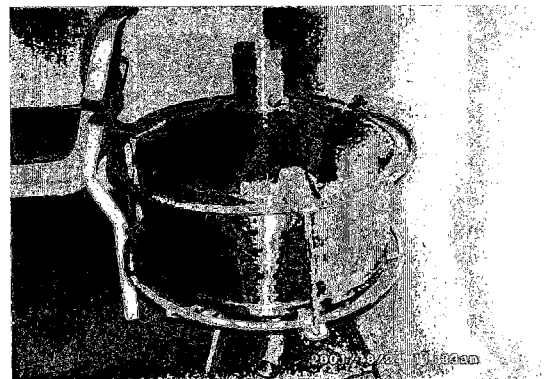






カンボジアMOI, バランサー(自作)




カンボジアMOI, Mr. Hul Lim, Under Secretary of State  
(中央座席背広着用)




カンボジア商業省、ガソリンのオクタン価計測機

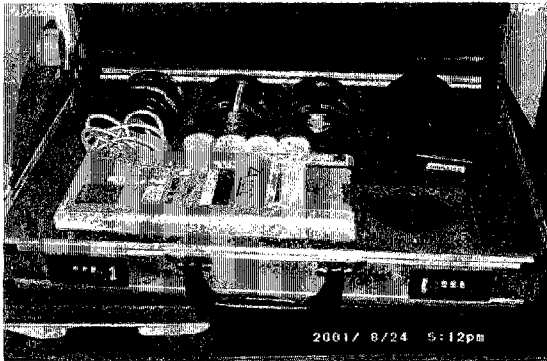


カンボジア商業省、バランサー

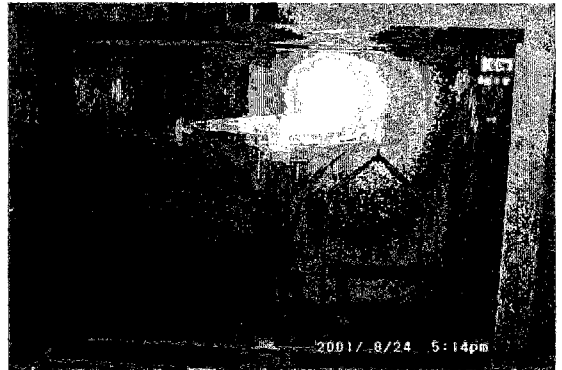

カンボジア商業省、Multi Function Analyzer (ガソリン用)

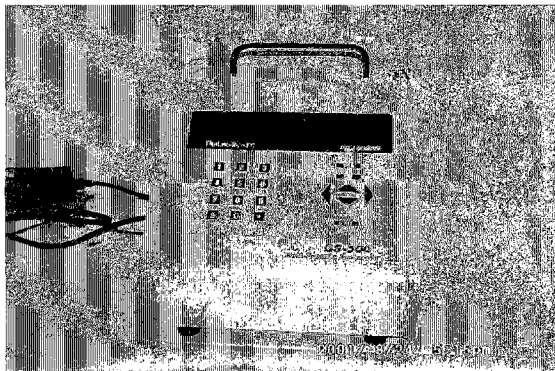


カンボジア商業省、ガソリン分析機

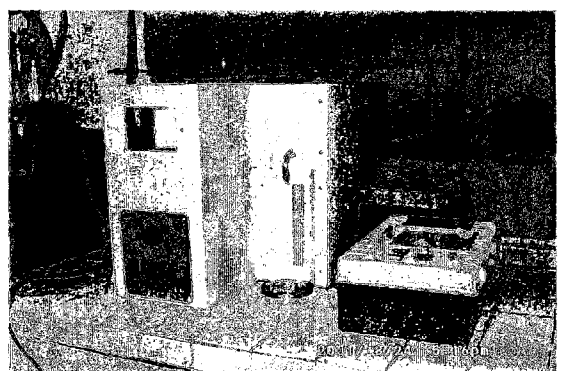




カンボジア商業省、水質試験機

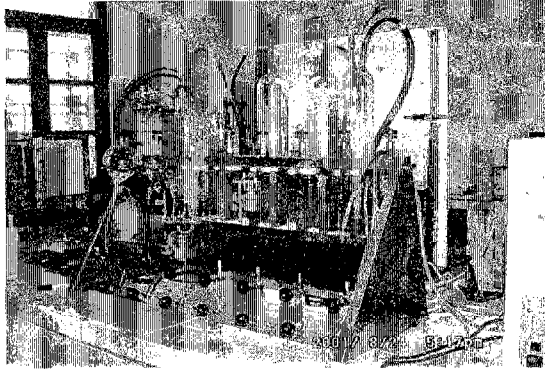

カンボジア商業省、ガソリン引火点試験機

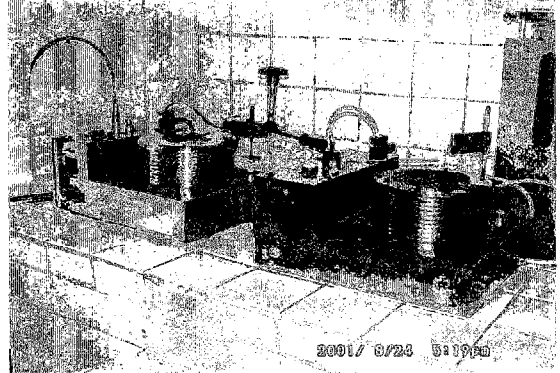

カンボジア商業省、ガス分析機




会談終了後、カンボジア商業省正面入口での写真撮影






ミヤンマMOI, 重量標準機

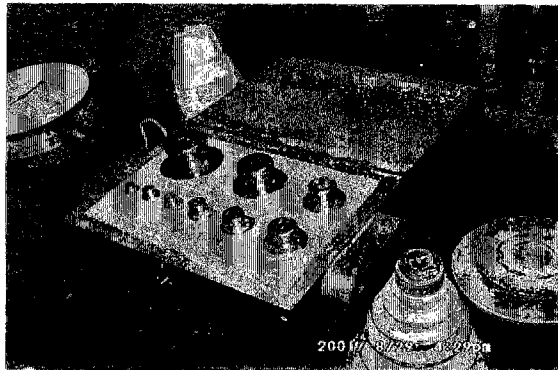

ミヤンマMOI, 重量標準機(ポンド単位)




ミヤンマMOI, 長さ標準機

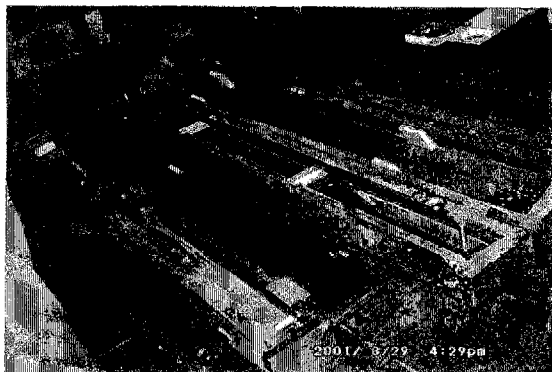


ミヤンマMOI, 長さ標準機



ミヤンマMOI, ブロックゲージ(メートル単位)

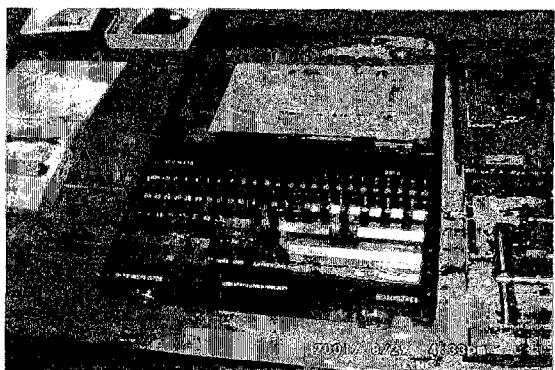


ミヤンマMOI, ブロックゲージ(インチ単位)

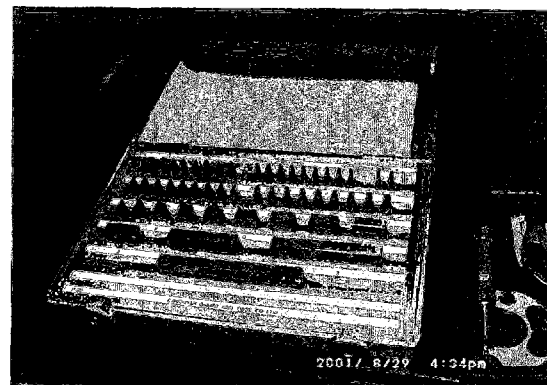




ミヤンマMOI, バランサー

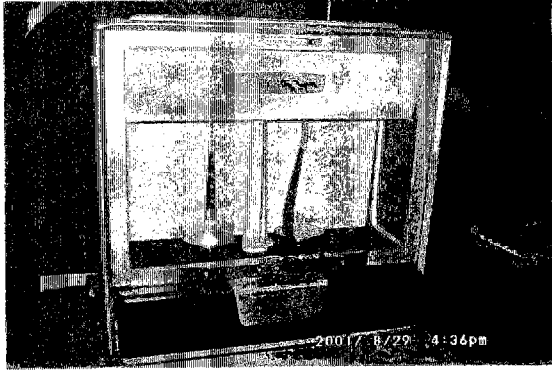


ミヤンマMOI, 容積標準機(ガロン単位)




ミヤンマMOI, 容積標準機(1/2 Gallon)

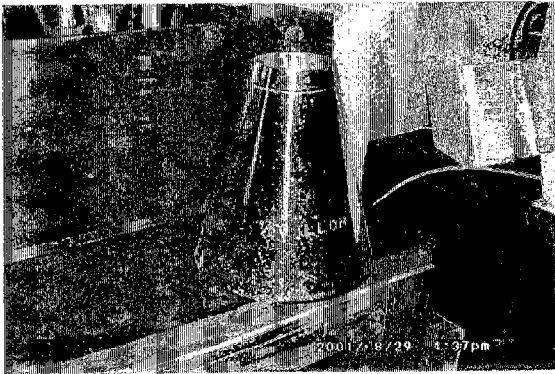


ミヤンマMOI, 圧力標準機

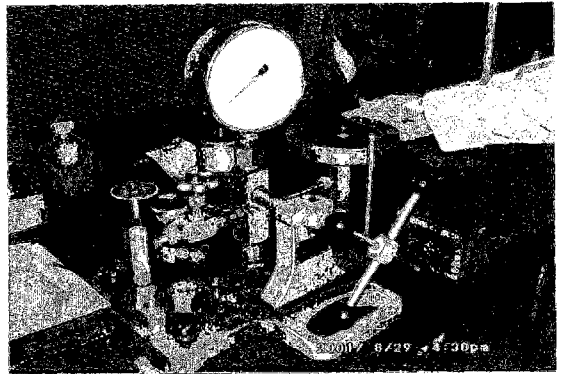

ミヤンマMOI, 顕微鏡

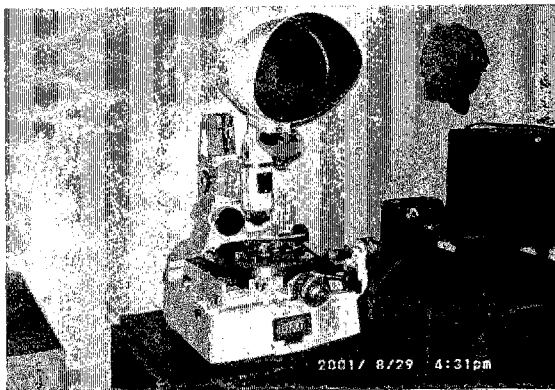


ミヤンマMOI, 化学試験室

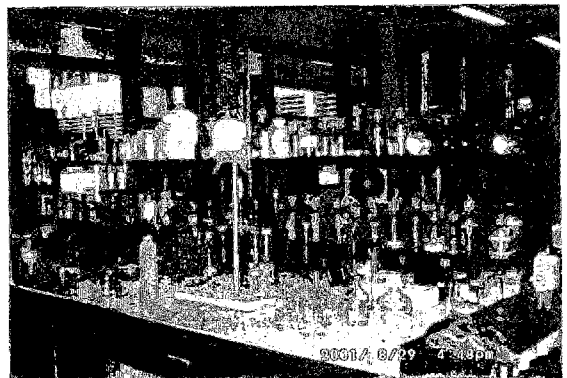





ミヤンマMOI, 水質分析試験

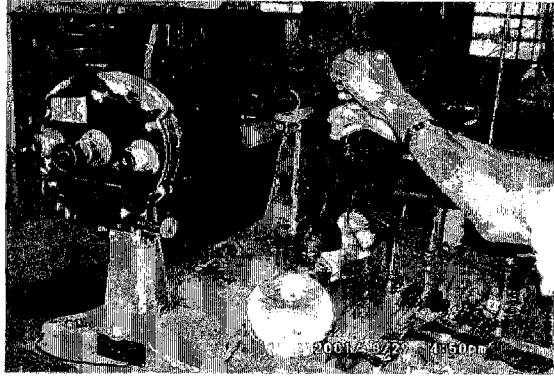

ミヤンマMOI, 工業省側出席者(右から3人目、Mr. Tin Htut (Director General), 最右端Dr.Kycaw Htut (Adviser))



