

No. 1

キルギス共和国
地方小児病院機材更新計画
予備調査報告書

JICA LIBRARY



1172582〔7〕

平成15年3月

国際協力事業団

無償二

JR

03-134

序文

日本国政府はキルギス共和国政府の要請に基づき、同国の地方小児病院機材更新計画に係る予備調査を行うことを決定し、国際協力事業団が平成15年2月3日から3月12日まで予備調査団を現地に派遣しました。

この報告書が、今後予定される基本設計調査の実施、その他関係者の参考として活用されれば幸いです。

終りに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。

平成15年3月

国際協力事業団
理事 吉永 國光



1172582【7】

Map of the Kyrgyz Republic





国立産科学・小児科学研究所事務棟




不調な心電計




唯一の酸素テント




不足しているインキュベーター・ベット

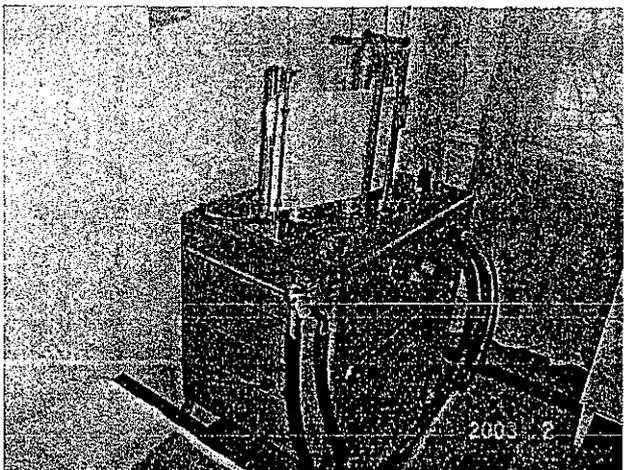


呼吸機能測定器

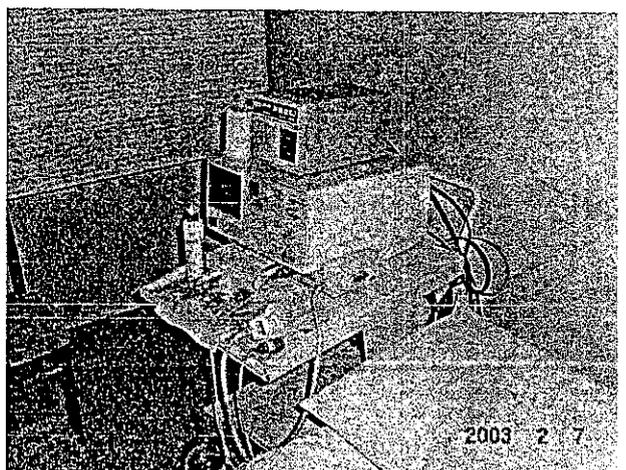

画像が不鮮明な超音波診断装置

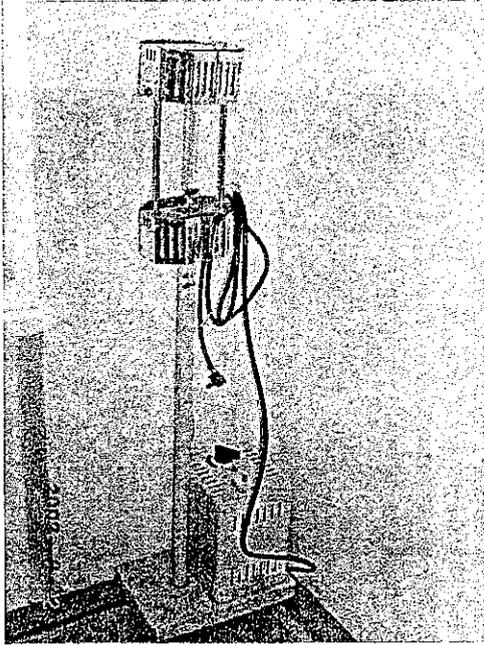

殺菌用石英ランプ

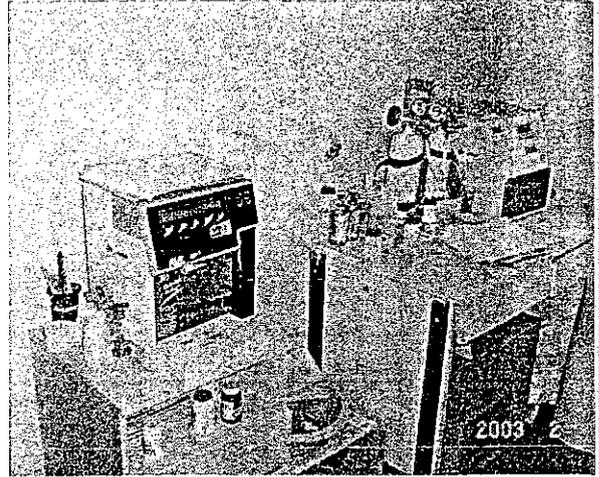


故障しているNa、K分析計・血液ガス分析計



使用できない分光光度計




単眼顕微鏡

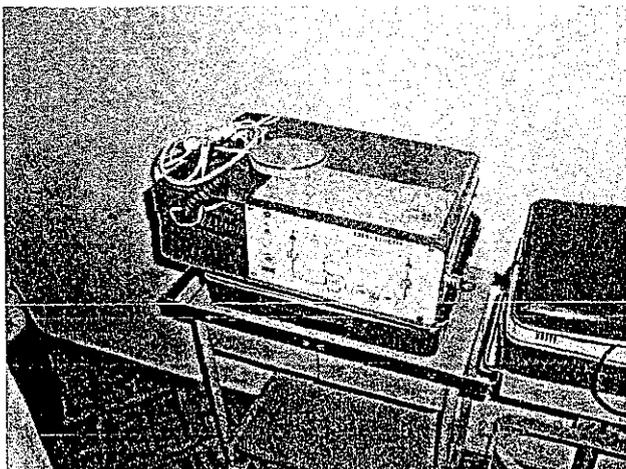


故障中の電気メス




使用できない呼吸器

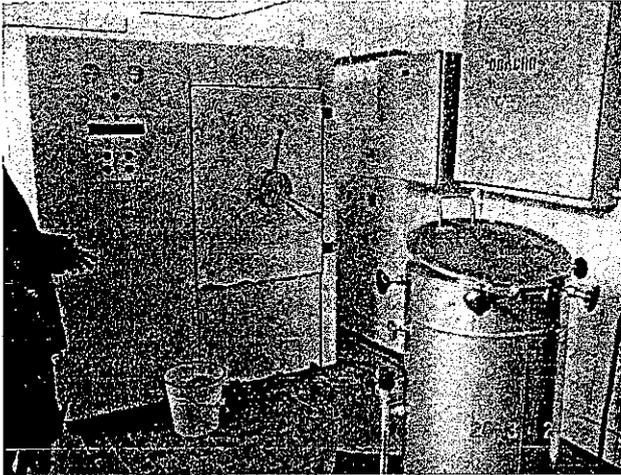


外科棟の滅菌室

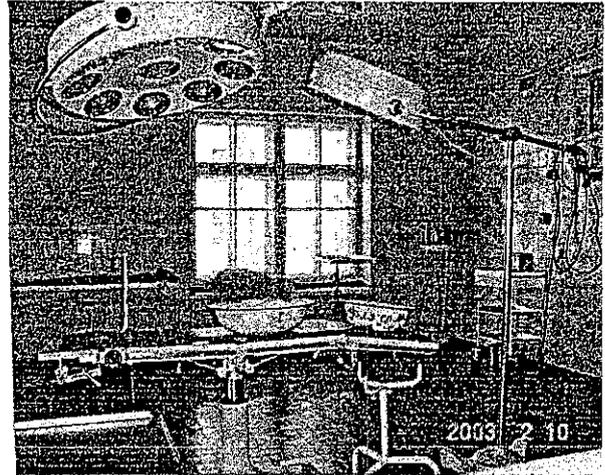


外科手術室1-2

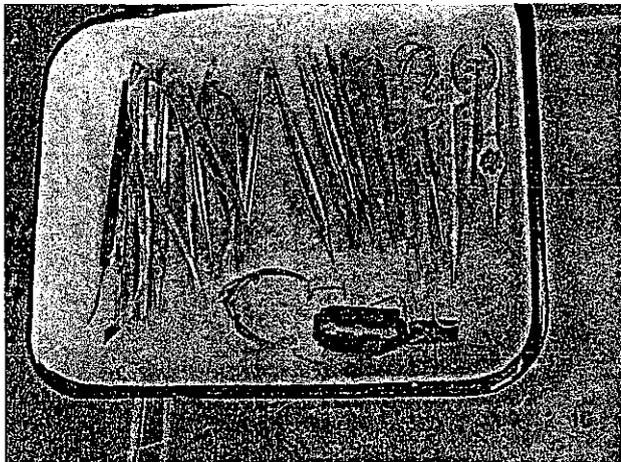


眼科手術器具

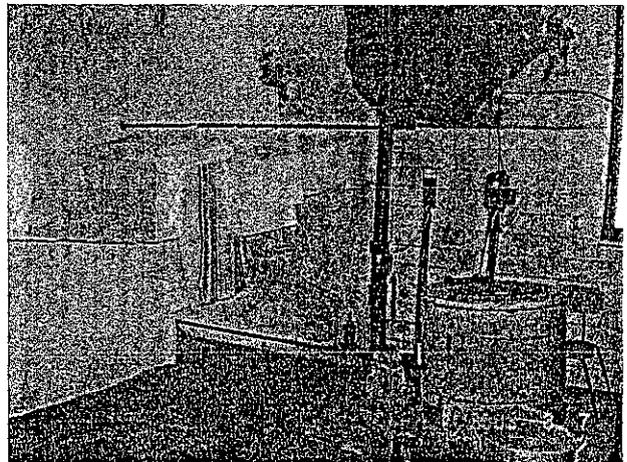

リハビリ科洗濯機

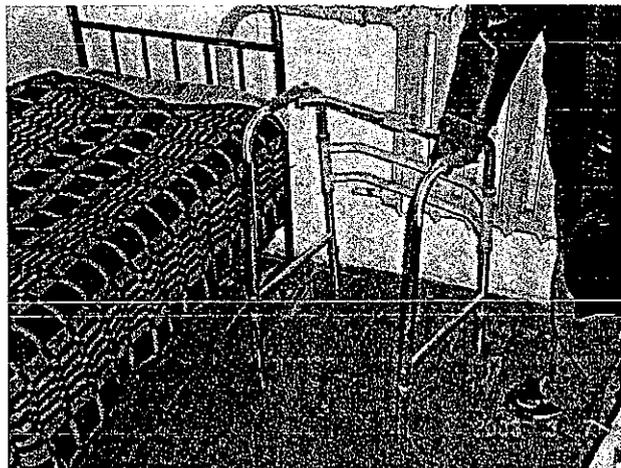

リハビリ科歩行補助具

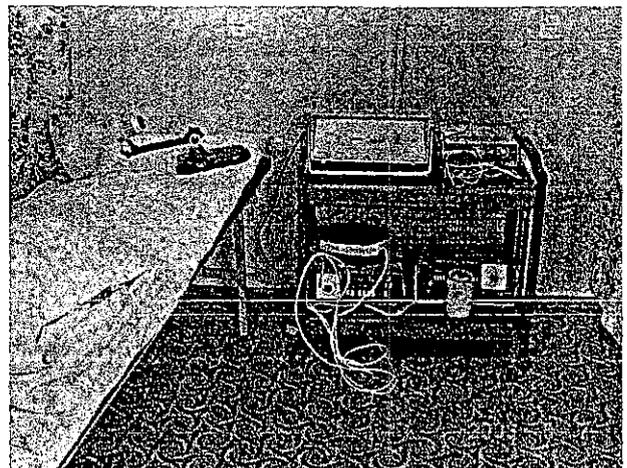

リハビリ科理学療法機器




1チャンネル心電計




CSSDオートクレーブ




シリンジポンプ

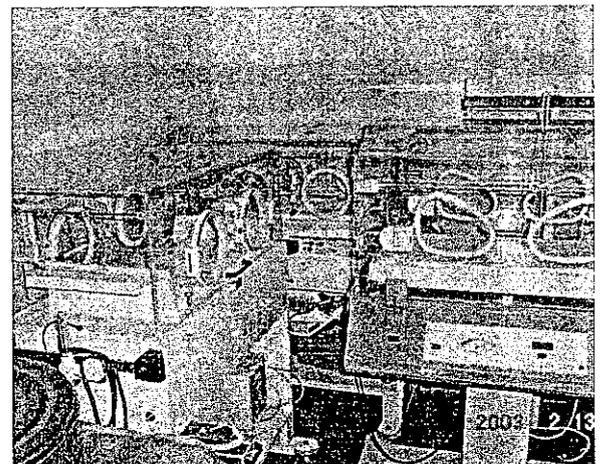


修理されていないインキュベーター

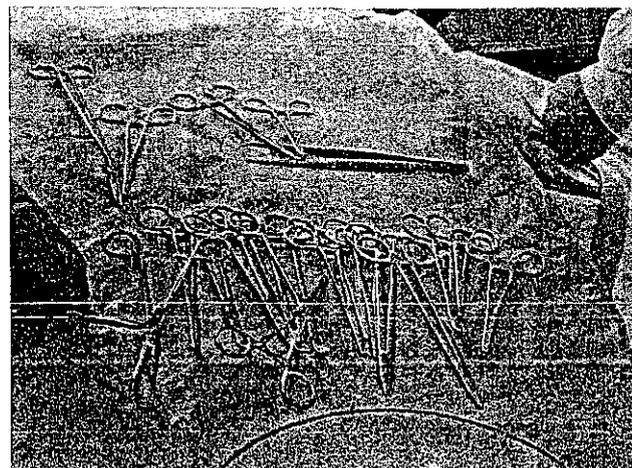


外科手術室・器具

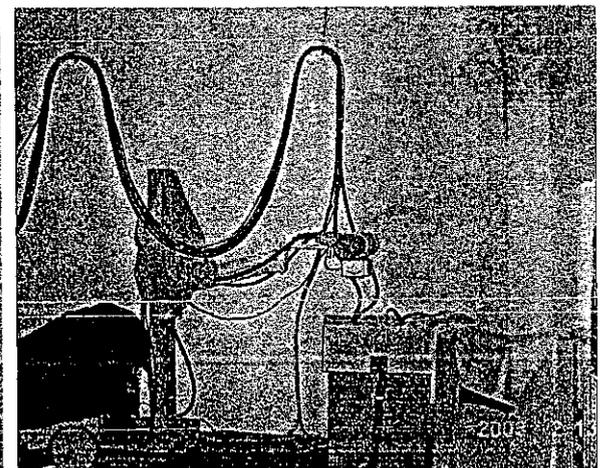


ソ連製モバイルX線・故障中

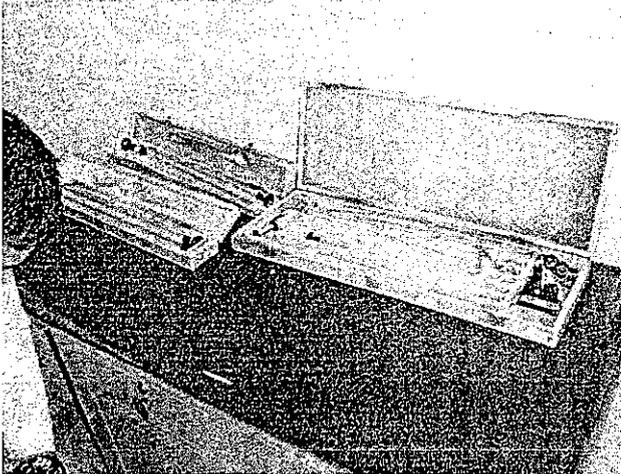


使用できなくなった内視鏡

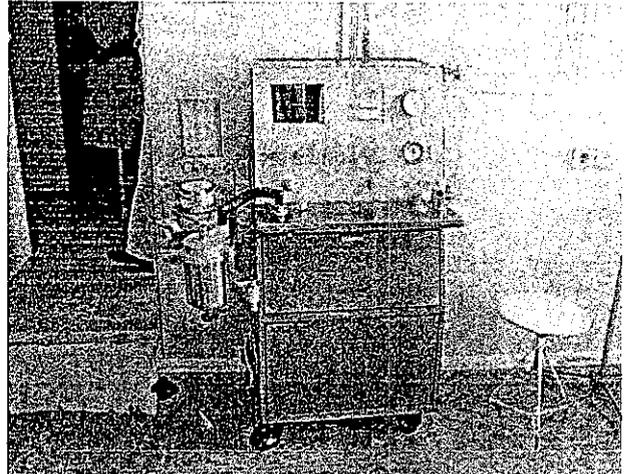


人工呼吸器

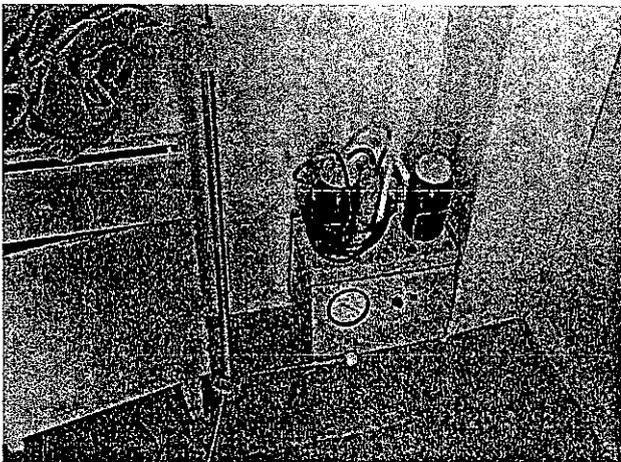


吸引器

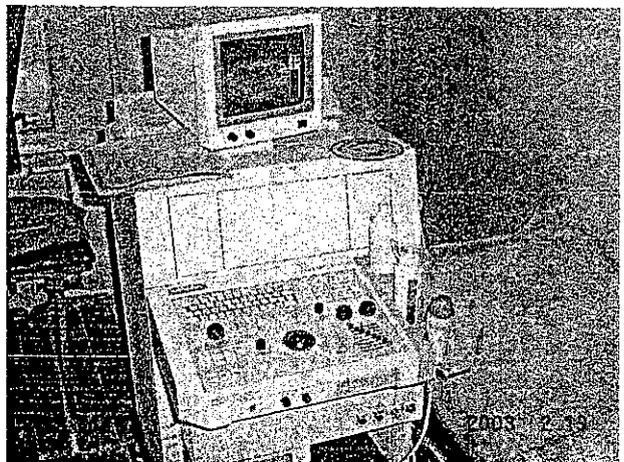

プローブが不足している超音波診断装置

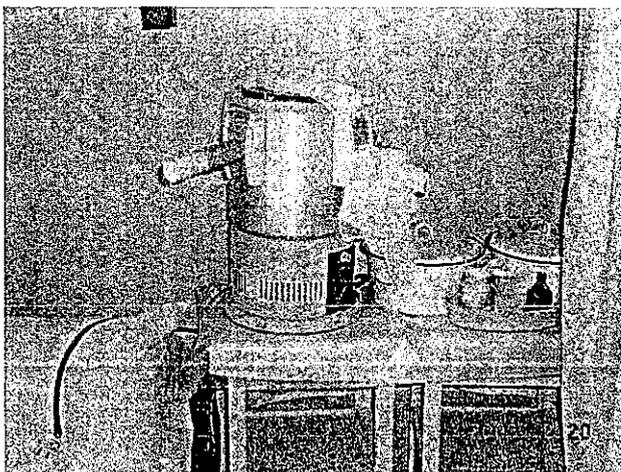


紫外線治療器

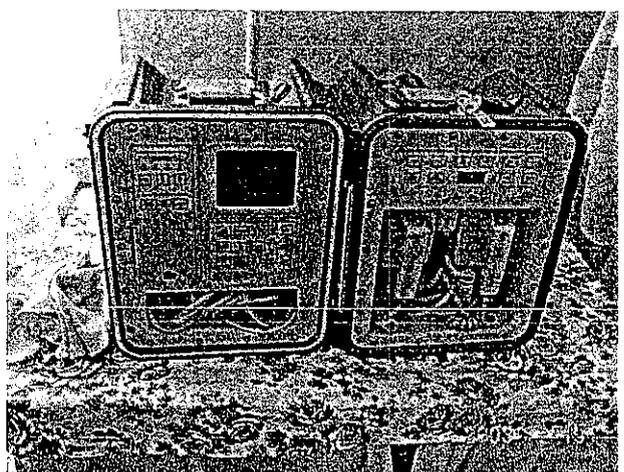


除細動装置




可動部分が壊れている手術台

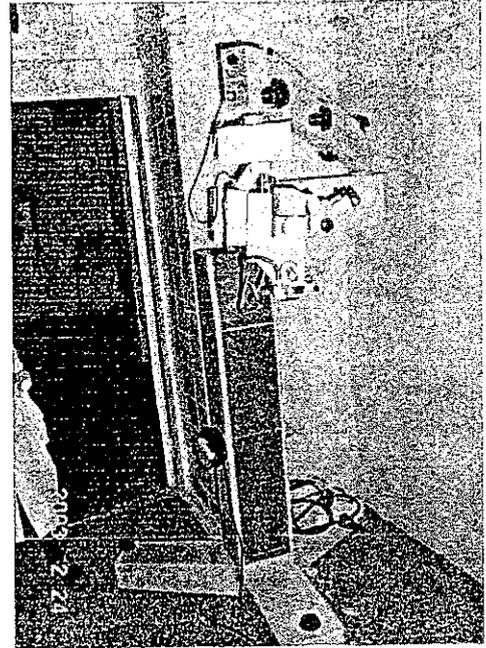


手術用顕微鏡

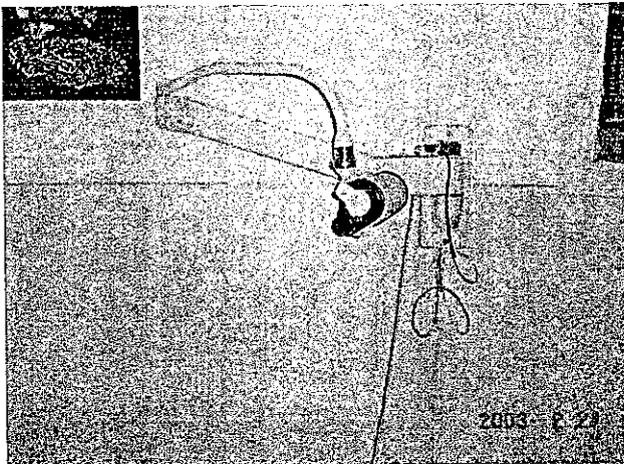


稼動していない歯科用レントゲン

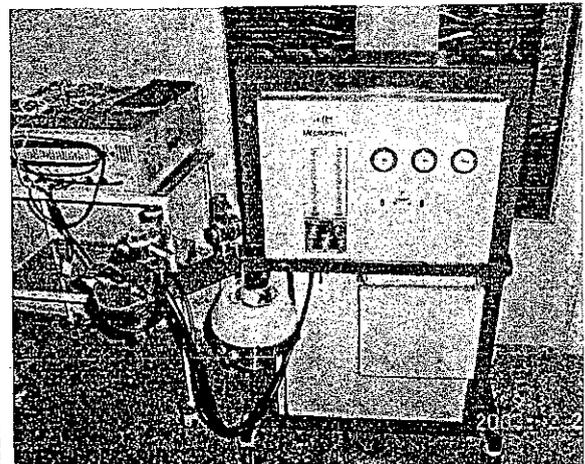

酸素供給器

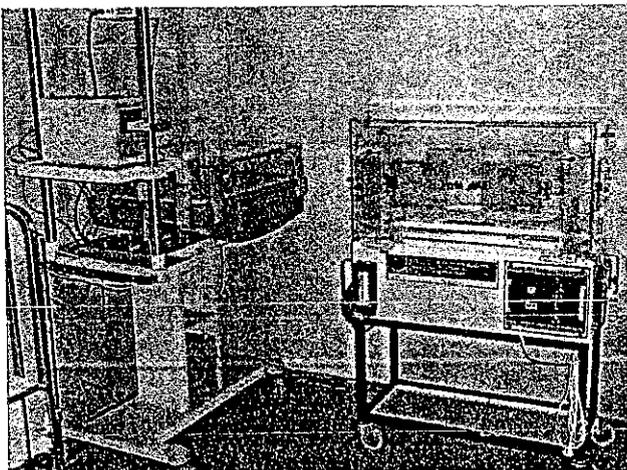

壊れている保育器と保温ランプ

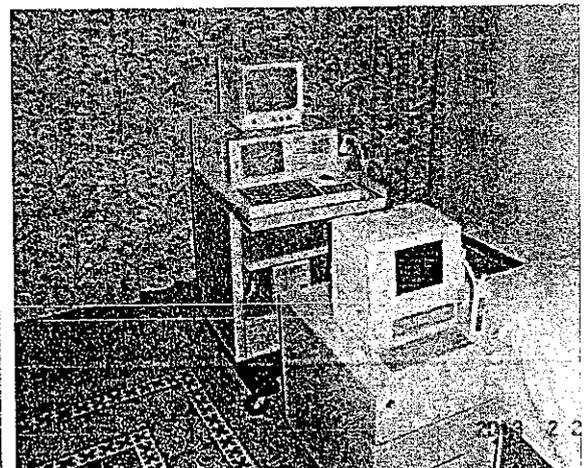


超音波診断装置

ジャラル・アバド州立統合病院




'99スイスからの援助の洗濯機(故障中)

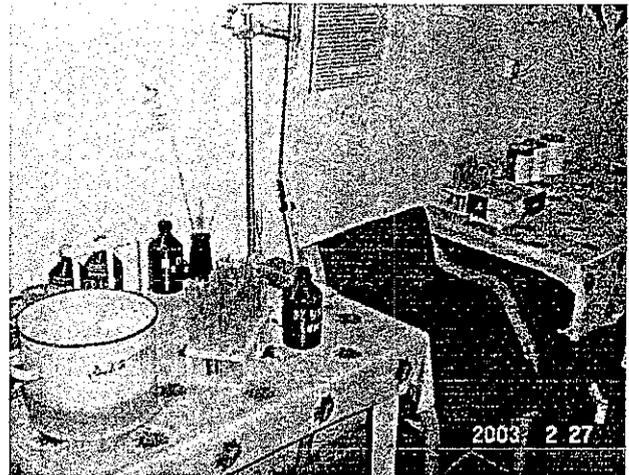


ほとんど破損している試験管




救急車(搬送車)

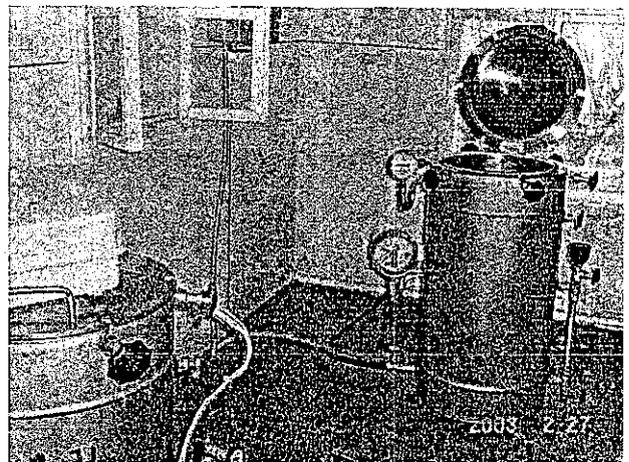


小児科用オートクレーブ

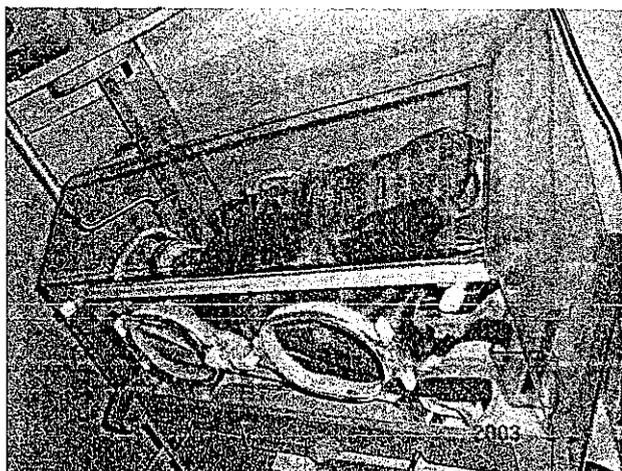


インキュベーター不足のため2人収容

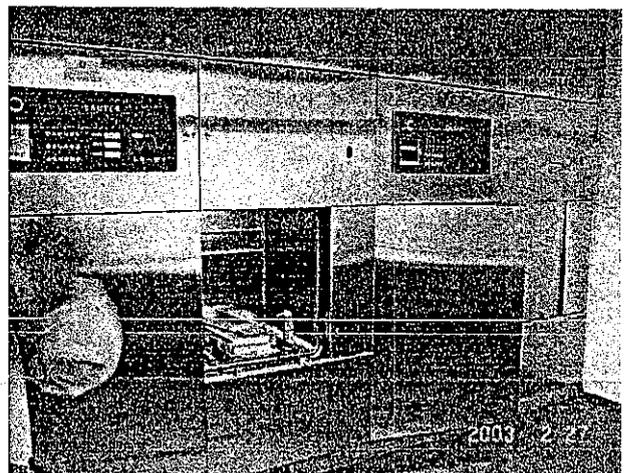

'99スイスからの援助のオートクレーブ2台(故障中)

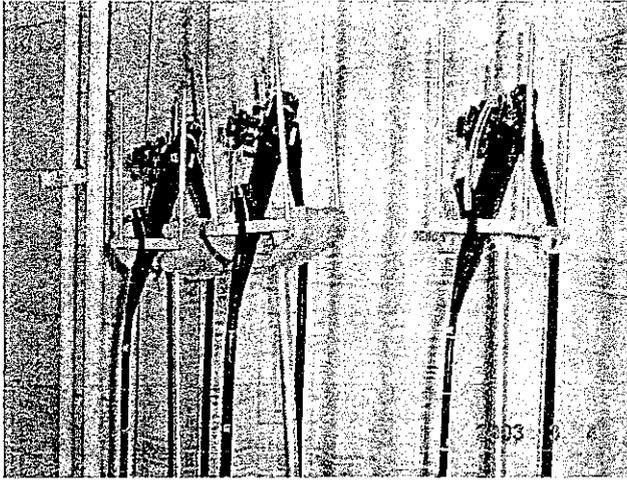


小児用プローブが無い

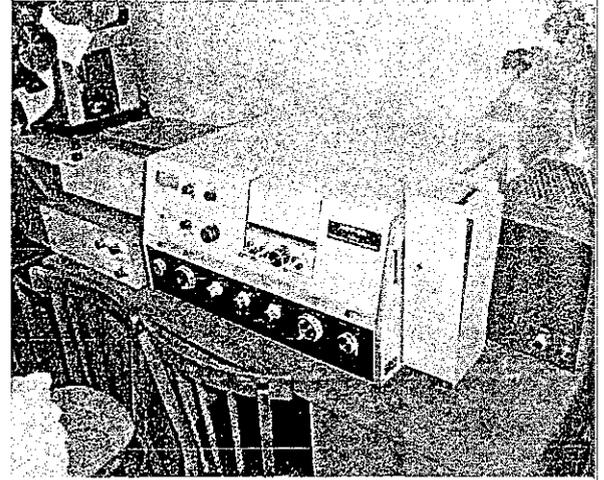


不調な分光光度計



硝子器具の不足

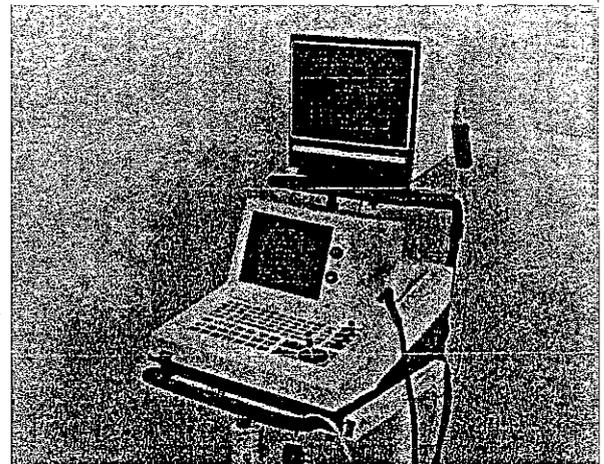

不足している超音波診断装置

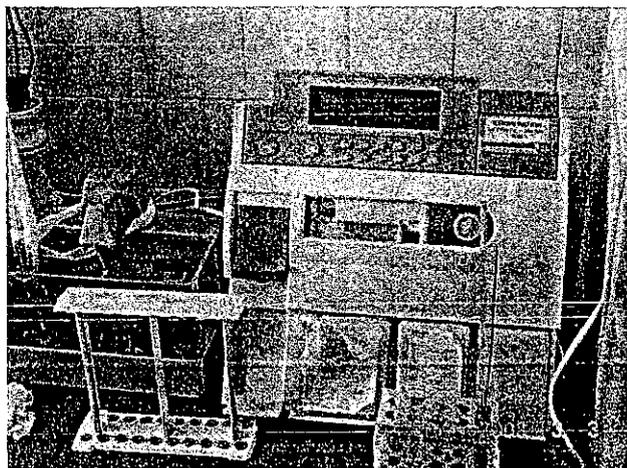

故障している生化学分析装置



メンテナンスが必要なMRI