

Resumen de Resultados de la Investigación sobre Condición de Salud en Santa Cruz

サンタクルスの保健医療状況調査
結果サマリー

14 de Marzo – 19 de Abril, 2001

ejectar por

**Equipo de
Estudio Preliminar para
el Proyecto de Fortalecimiento de la Red de Salud Regional
en el Departamento Santa Cruz**

**JICA
(Japan International Cooperation Agency)**



Estudio Preparatorio

Proyecto Fortalecimiento de la Red de Salud Regional en Santa Cruz

1. Objetivos

- **Decidir los Componentes de Proyecto**
 - *Meta(Target)*
 - Areas de Modelo (Piloto)
 - Programas
 - Actividades

2. Metodología

- **Análisis de Instituciones Relacionadas:**
 - Entrevista
 - *ID/OS*
- **Investigación local; Districtos de Salud (Candidatos de Area Piloto)**
 - Distrito II, III, V (Ciudad de Santa Cruz)
 - Distrito Warnes, Norte, Oeste(Porongo)
 - Encuesta (y Entrevista, Observación directa)
 - ◇ Comunidad (Población) : *Household Survey*
 - ◇ Instituciones de Salud (Hospital, Centro de Salud, Puesto de Salud) :
 - Encuesta al Paciente (*Excit Survey*)
 - Entrevista al Personal de Instituciones de Salud
 - Investigación de Equipamiento
- **Taller de *PCM*: Elaboración de *PDM***

3. Cronograma

Tiempo: 14 marzo 2001 ~ 6 abril 2001

4. Objetos de estudio

La Paz

- ◇ Ministerio de Salud y Previsión Social
- ◇ Ministerio de Inversión
- ◇ Organizaciones Internacionales ; UNICEF, USAID, PAHO, BID
- ◇ ONG y otras Organizaciones ; MSH, Cooperación Técnica Bélgica
- ◇ Oficina de JICA
- ◇ Embajada del Japón

Santa Cruz

Departamento de Santa Cruz

- ◇ Prefecto
- ◇ SEDES
- ◇ Oficina de Distrito Regional (Warnes, Norte y Oeste)
- ◇ Hospital Regional (Warnes y Montero)
- ◇ Hospital Colonia Japonesa (Okinawa y San Juan)
- ◇ Cento de Saludo y Puesto de Salud
- ◇ UNFPA
- ◇ ONG (PROSALUD)
- ◇ Cooperacion Técnica Bélgica, Cooperacion Holandesa (PAP)
- ◇ Colegio Medico, Cruz Roja
- ◇ Consulado del Japón
- ◇ Oficina de JICA Santa Cruz

Municipio Santa Cruz

- ◇ DMS
- ◇ Hospitales de Tercero Nivel
 - * HUI, SJDD, Maternidad, Niño y Oncológico
- ◇ Cento de Saludo y Puesto de Salud
- ◇ SISME

Población (Distrito II, III, V, Warnes, Okinawa, Momtero y Porongo)

Marco Conceptual del Proyecto

➤ **Nombre:**

*Proyecto Fortalecimiento de la Red de Salud Regional en Santa Cruz
(Provisional)*

➤ **Modalidad de Asistencia:**

Cooperación Técnica Tipo Proyecto (JICA)

➤ **Periodo del Proyecto:**

5 años (AF2001-)

➤ **Objeto del Proyecto:**

Población del Departamento de Santa Cruz centrado a la población indigente

✧ **Areas de Modelo (Piloto):**

- Distrito II, III (Ciudad de Santa Cruz)
- Distrito Warnes, Norte

✧ **Programas:**

- *Maternoinfantil*
- *Tuberculosis*
- *Nutrición*

✧ **Metodología:**

- *Fortalecimiento de las Funciones en las Instituciones del Primer y Segundo Nivel; Parte Administrativa y Clínico*
- *Fortalecimiento del Sistema Interinstitucional de Salud (Sistema de Referencia - Contrareferencia y SISME)*
- *Fortalecimiento del Mantenimiento de Equipos Médicos*
- *Fortalecimiento del Mecanismo de las Instituciones Ejecutoras (SEDES y DMS)*
- *Promoción de Salud (Educación poblacional)*
- *Comunicación y Divulgación*
- *Capacitación*

➤ **Niveles (Contrapartes):**

- ❖ *SEDES, DMS*
- ❖ *SISME*
- ❖ *Oficina de Distritos (Areas de Piloto)*
- ❖ *Centro de Salud y Hospital de Segundo Nivel (Modelos)*
- ❖ *(Hospital de Tercero Nivel)*

➤ **Instituciones Responsables:**

- ❖ SEDES

➤ **Meta:**

➤ **Propósito del Proyecto:**

➤ **Componentes (Actividades):**

Indicadores:

➤ **Inversiones:**


- ❖ **Lado Japonés**
 - **Expertos**
 - **Becas**
 - **Equipos**
 - **Infraestructores**

- ❖ **Lado Boliviano**

Plan operativo

Proyecto Fortalecimiento de la Red de Salud Regional en Santa Cruz
Marco Conceptual

Departamento de Santa Cruz

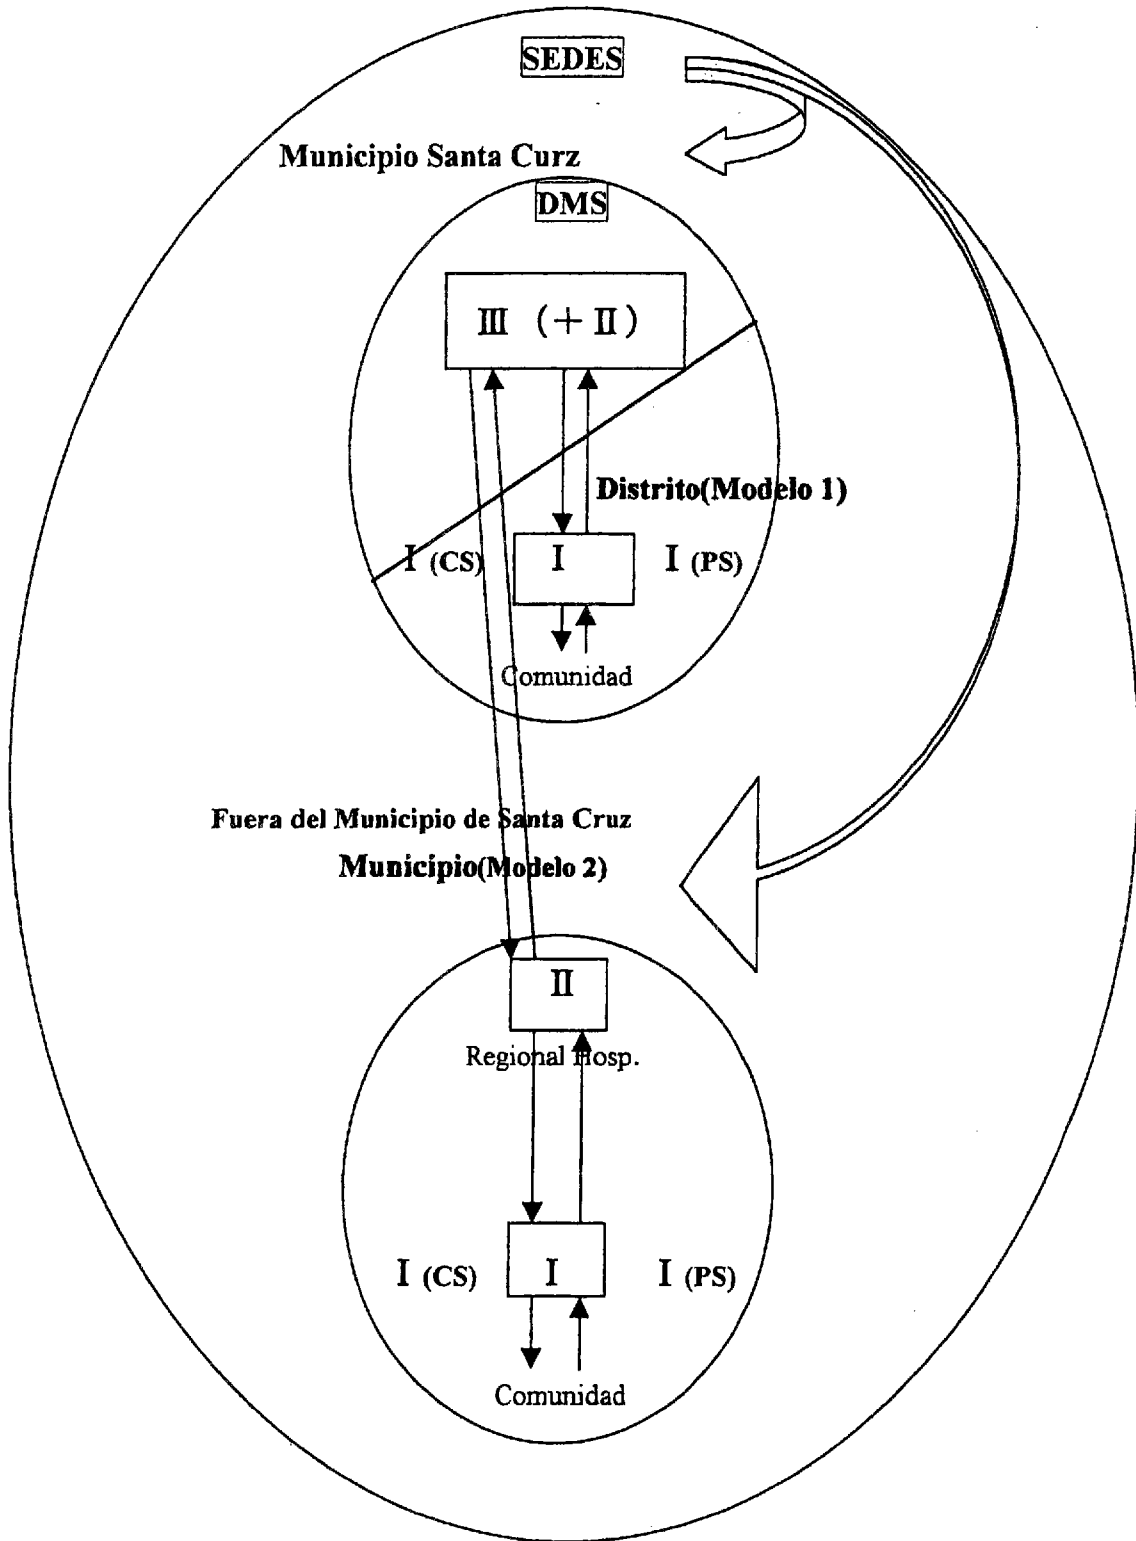

Proyecto Fortalecimiento de la Red de Salud Regional en Santa Cruz

| Intervención | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Programa | Metodo | Nivel | Area(Piloto) |
| Maternidad | <i>Fortalecimiento de las Funciones en las Instituciones del Primer y Segundo Nivel</i> | I, II (III) | |
| | <i>Fortalecimiento del Sistema Interinstitucional de Salud</i> | I ~III | |
| | <i>Mantenimiento de Equipos Médicos</i> | DMS | |
| | <i>Comunicación y Divulgación</i> | SEDES | |
| | <i>Promoción de Salud (Educación poblacional)</i> | I, SEDES | |
| | <i>Capacitación</i> | III, SEDES | |
| Tuberculosis | <i>Fortalecimiento de las Funciones en las Instituciones del Primer y Segundo Nivel</i> | I, II (III) | |
| | <i>Fortalecimiento del Sistema Interinstitucional de Salud</i> | I ~III | |
| | <i>Mantenimiento de Equipos Médicos</i> | DMS | |
| | <i>Comunicación y Divulgación</i> | SEDES | |
| | <i>Promoción de Salud (Educación poblacional)</i> | I, SEDES | |
| | <i>Capacitación</i> | III, SEDES | |
| Nutrición | <i>Comunicación y Divulgación</i> | SEDES | |
| | <i>Promoción de Salud (Educación poblacional)</i> | I, SEDES | |
| | <i>Capacitación</i> | III, SEDES | |

Intervención

A. Fortalecimiento de las Funciones en las Instituciones del Primer y Segundo Nivel;

- *Equipamiento y Infraestructura*
- *Mejoramiento de Parte Administrativo*
- *Mejoramiento de Parte Clínico*
- *Promoción de Salud*

B. Fortalecimiento del Sistema Interinstitucional de Salud

- *Sistema de Referencia - Contrareferencia*
- *SISME*
- *Mantenimiento de Equipos Médicos*

C. Fortalecimiento del Mecanismo de las Instituciones Ejecutoras

- *SEDES*
 - *Planificación*
 - *Comunicación y Divulgación*
 - *Capacitación*
- *Oficina de Distrito de Salud*
- *DMS*

Servicio de Instituciones de Salud

医療施設サービス

| Nombre 名前 | Live | Distrit | Horario de attenci | Parto分娩 | Quirofano手術 | Labo | Rayos X | Echo超音波 | Endoscop | Farmacia薬剤充足 | Oxigen |
|------------------------|------|---------|--------------------|---------|-------------|------|---------|--------------|----------|-----------------------|--------|
| Norte | CS | D2 | 24hr | Si | No | No | No | Drが持参 | No | Disponible充足 | Si |
| 10 de Octubr | CS | D2 | 24hr | Si | No | No | No | Si(no stabil | No | Disponible充足 | Si |
| La Fortaleza | CS | D3 | 12hr(Dr.4hr) | No | No | No | No | No | No | Disponible充足 (BS) | Si |
| Palmar del Oratorio | MH | D3 | 4hr(AM) | Si | No | No | No | No | No | Indisponible薬なし | No |
| La Colorada | CS | D3 | No sevicio | | | | | | | | |
| El | CS | D3 | 24hr | Si | No | No | No | No | No | Disponible充足 (BS) | Si |
| 18 de Marzo | CS | D5 | 24hr | Si | No | Si | No | Drが持参 | No | Disponible充足 | Si |
| San | CS | D5 | 24hr | Si | No | No | No | No | No | | Si |
| Prevent | CS | D5 | 24hr | Si | No | No | No | No | No | Disponible充足 | Si |
| | | | | | | | | | | | |
| San Juan Bautista | CS | Oeste | 24hr | Si | No | Si | No | No | No | Disponible充足(SB+FR) | Si |
| Romulo Gomez Morales | MH | Oeste | 24hr | Si | No(部屋のみ) | Si | No | Si(修理中) | No | Disponible充足(SB+FR) | Si |
| El Torno | MH | Oeste | 24hr | Si | Si | Si | No | No | No | Disponible充足 | Si |
| Barreras | CS | Wames | 24hr(Dr.8hr) | No | No | No | No | No | No | Disponible充足 (BS) | No |
| Okinawa | MH | Wames | 24hr | Si | No | Si | No | No | No | | |
| Mario Daza Cronenbold | CS | Norte | 24hr | Si | No(部屋のみ) | Si | Si | No | No | Disponible充足(SB+FR) | Si |
| San Juan de Yapacani | MH | Ichilo | 12hr | Si | No | No | No | No | No | Disponible充足 (BS) | Si |
| | | | | | | | | | | | |
| Nuestra Sra. Del Rosar | DH | Wames | 24hr | Si | Si | Si | Si | Si | No | Disponible (SB+FR+CN) | Si |
| Montero | DH | Norte | 24hr | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Dispcnible充足 | Si |
| | | | | | | | | | | | |
| Juan | PS | Wames | 24hr(Ns近住) | No | No | No | No | No | No | Indisponible薬不足 | No |

Actividad de Instituciones de Salud

医療施設の活動

| Nombre 名前 | Live | Distrit | N. de consulta externa/dia外 | N. de inmunizaci | N. de parto/mes月間 |
|------------------------|------|---------|-----------------------------|------------------|-------------------|
| Norte | CS | D2 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆1/2 |
| 10 de Octubr | CS | D2 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
| La Fortaleza | CS | D3 | ☆☆ | ☆☆ | 0 |
| Palm | MH | D3 | ☆ | ☆1/3 | ☆1/2 |
| La Colorada | CS | D3 | | | |
| El | CS | D3 | ☆☆ | ☆ | ☆☆ |
| 18 de Marzo | rCS | D5 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | | ☆☆☆☆☆ |
| San | CS | D5 | ☆☆☆☆☆☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆☆1/2 |
| Prevent | CS | D5 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
| San Juan Bauti | CS | Oeste | ☆☆ | ☆1/2 | ☆1/2 |
| Ro | MH | Oeste | ☆☆☆ | ☆☆☆1/2 | ☆☆☆☆ |
| El Torno | MH | Oeste | ☆☆☆☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆☆☆1/2 |
| Barreras | CS | Warnes | ☆1/2 | ☆1/3 | 0 |
| Okinawa | MH | Warnes | ☆☆☆ | | ☆☆ |
| Mario Daza Cronenbold | CS | Norte | ☆☆☆☆ | ☆☆☆1/2 | ☆☆☆ |
| San Juan de Yapacani | MH | Ichilo | ☆1/2 | | ☆1/2 |
| Nuestra Sra. Del Rosar | DH | Warnes | | | |
| Montero | DH | Norte | ☆☆☆☆☆☆ | ☆☆☆1/2 | ☆ |
| Juan LATINO | PS | Warnes | ☆ | | 0 |

☆ = 10 personas

Numero de Personal 職員数

| Nombre 名前 | Live | Distrit | N. de Doct | Enfermer | Dentist | Farmacaceutic | Labo. Te | Otre |
|------------------------|------|---------|------------|----------|---------|---------------|----------|------------------------|
| Norte | CS | D2 | 1, ano3 | 2 | 2 | 0 | 0 | Admini 2 |
| 10 de Octubr | CS | D2 | 4, ano2 | 5 | 1, ano1 | 0 | 0 | Ad |
| La Fortaleza | CS | D3 | 1, ano1 | 3 | 1, ano1 | 0 | 0 | Admini 1 |
| Palmar del Oratorio | MH | D3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| La Colorada | CS | D3 | | | | | | |
| El | CS | D3 | 4, ano1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 de Marzo | rCS | D5 | 4 | 7 | Si | 1 | 2 | Ad |
| San | CS | D5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| Prevent | CS | D5 | 4, ano1 | 10 | Si | 0 | 0 | Admini 2 |
| | | | | | | | | |
| San Juan Bautista | CS | Oeste | 1, ano2 | 5, ano1 | 1, ano1 | 0 | 1 | Admini 1 |
| Romulo Gomez Morales | MH | Oeste | 2, ano1 | 7 | 3 | 2 | 1 | |
| El Torno | MH | Oeste | 2 | 2 | | | | |
| Barreras | CS | Warnes | 1 | 1 | 0 | | 0 | |
| Okinawa | MH | Warnes | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | Admini 1 |
| Mario Daza Cronenbold | CS | Norte | 3, ano1 | 9 | 2 ano1 | | 1 | Ad |
| San Juan de Yapacani | MH | Ichilo | 1 | 1 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| Nuestra Sra. Del Rosar | DH | Warnes | 13 | 9 | Si | 2 | 5 | X-P, Admin |
| Montero | DH | Norte | 10 | 36 | Si | Si | Si | Anesthe 3, X-P, Admini |
| | | | | | | | | |
| Juan | PS | Warnes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |


Comunicacion/Transporte/Refarencia

医療施設の通信・移送・リフェラル


| Nombre名前 | Live | Distrit | Telfon | Radio無料 | Ambulanci | SISME | Labo. refa | Hp ref |
|------------------------|------|---------|--------------|----------|-----------|-------|--------------------|--------------------------------------|
| Norte | CS | D2 | Yes | No | No | No | | HUJ |
| 10 de Octubr | CS | D2 | Public | No | No | No | rCS | HUJ |
| La Fortaleza | CS | D3 | Public | No | No | No | 患者の好きな所(rC | rCS(parto), HSJD |
| Palmar del Oratorio | MH | D3 | No | No | No | No | | HUJ, HMI, HSJD |
| La Colorada | CS | D3 | | | | | | |
| El | CS | D3 | No | No | No | Si | rCS | HUJ, etc. |
| 18 de Marzo | rCS | D5 | Yes(+Public) | No | No | No | | HUJ, HMI, HSJD |
| San | CS | D5 | Yes | No | No | No | rCS | HUJ, HMI |
| Prevent | CS | D5 | Yes | No | No | No | rCS | HUJ |
| | | | | | | | | |
| San Juan Bautista | CS | Oeste | Public | Si(通じなし) | No | No | CENETROP、Guardia | Torno privad(Echo、X-P)、HM |
| Romulo Gomez Mora | MH | Oeste | Public | Si(通じなし) | Si | No | CENETROP | HMI, HSJD |
| El Torno | MH | Oeste | Public | No | No | No | | |
| Barreras | CS | Warnes | Public | No | No | No | | |
| Okinawa | MH | Warnes | | | No | No | Hp Okinawa Japones | |
| Mario Daza Cronenbold | CS | Norte | Yes | Si | No | No | | Hp Montero, HUJ, HSJD |
| San Juan de Yapaca | MH | Ichilo | Public | No | No | No | Hp San Car | Hp San Juan Japones(X-P), Hp Montero |
| | | | | | | | | |
| Nuestra Sra. Del Rosar | DH | Warnes | Yes(料金未) | No | Si | No | | |
| Montero | DH | Norte | Yes | Si | Si 4 | No | | HUJ |
| | | | | | | | | |
| Juan | PS | Warnes | | No | No | No | | |

Insatisfaccion de Trabajo


仕事の不満足の理由

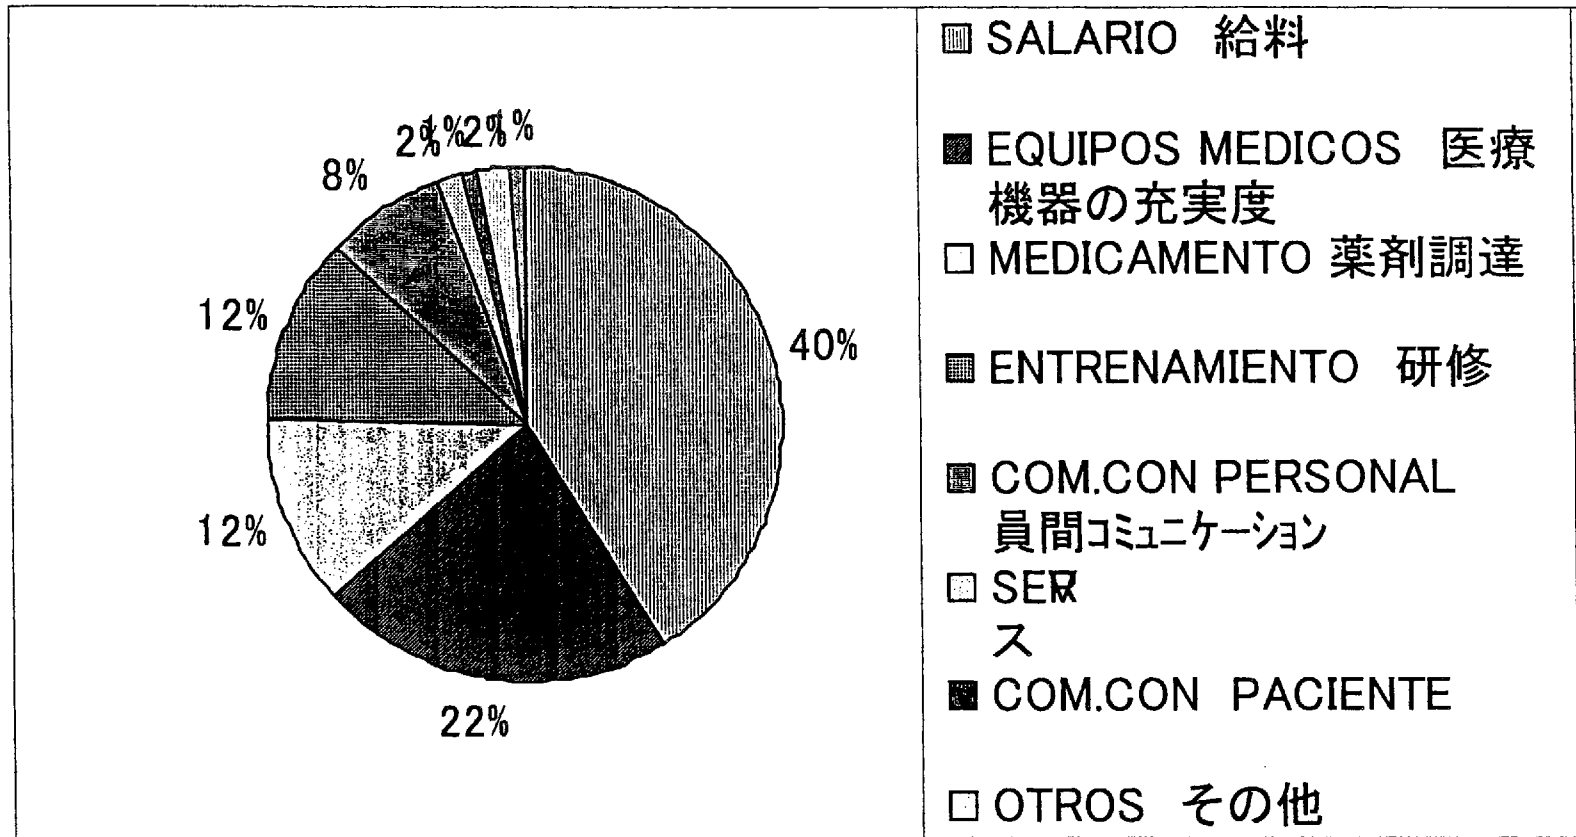


EDAD PACIENTE, CENTRO DE SALUD 患者年齡 (n=71)




EDAD PACIENTE, HOSPITAL 患者年齡 (n=50)



TIENPO ESPERA, HOSPITAL 待ち時間(n=50)

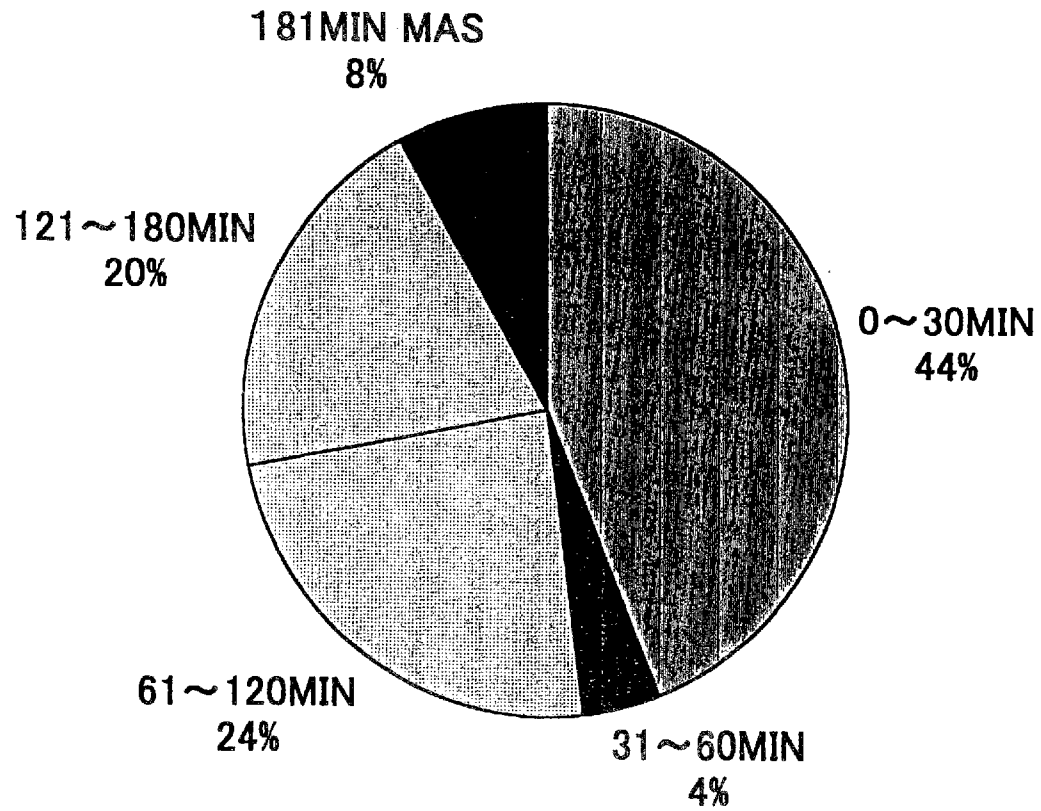


TIEMPO ESPERA, CENTRO DE SALUD 待ち時間(n=71)



TOTAL GASTOS

総治療費 (n=12)




Sobre
Centro de Salud
y Hospital

EVALUACION


患者の評価 (n=121)

| | RECEPCIONISTA | DOCTORES | ENFERMERAS | INSTITUCION | COSTO | CONSULTA |
|----------------|---------------|----------|------------|-------------|-------|----------|
| NO CONOCE 知らない | 12 | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| MUY BUENO 大変良い | 3 | 15 | 8 | 4 | 13 | 6 |
| BUENO 良い | 82 | 94 | 80 | 92 | 81 | 90 |
| REGULAR 普通 | 21 | 7 | 20 | 23 | 21 | 12 |
| MALO 悪い | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| PESIMO 最悪 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |


SEGURO BASICO DE SALUD 基礎保健(n=58)

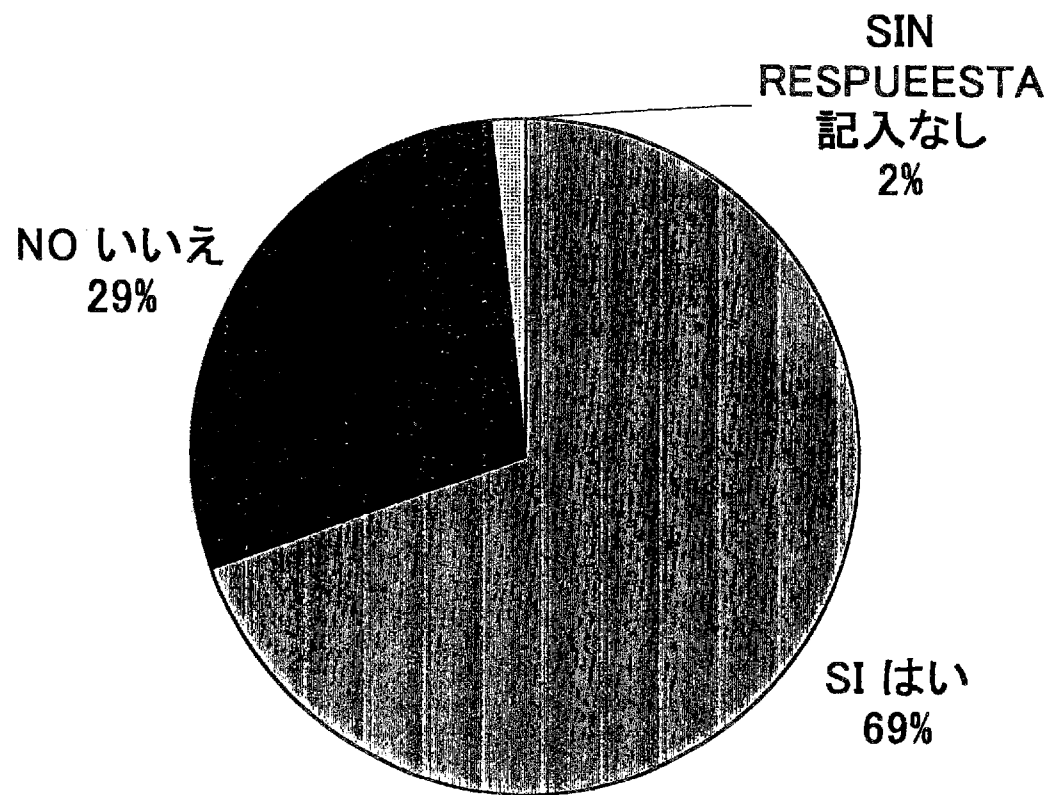


PRENATAL 妊婦検診(n=68)




PLANIFICACION FAMILIAL 家族計画 (n=72)




RIESGO DE CONTRAER 結核(n=72)



GRASA CORPORAL(M) 体脂肪率 男性(n=13)

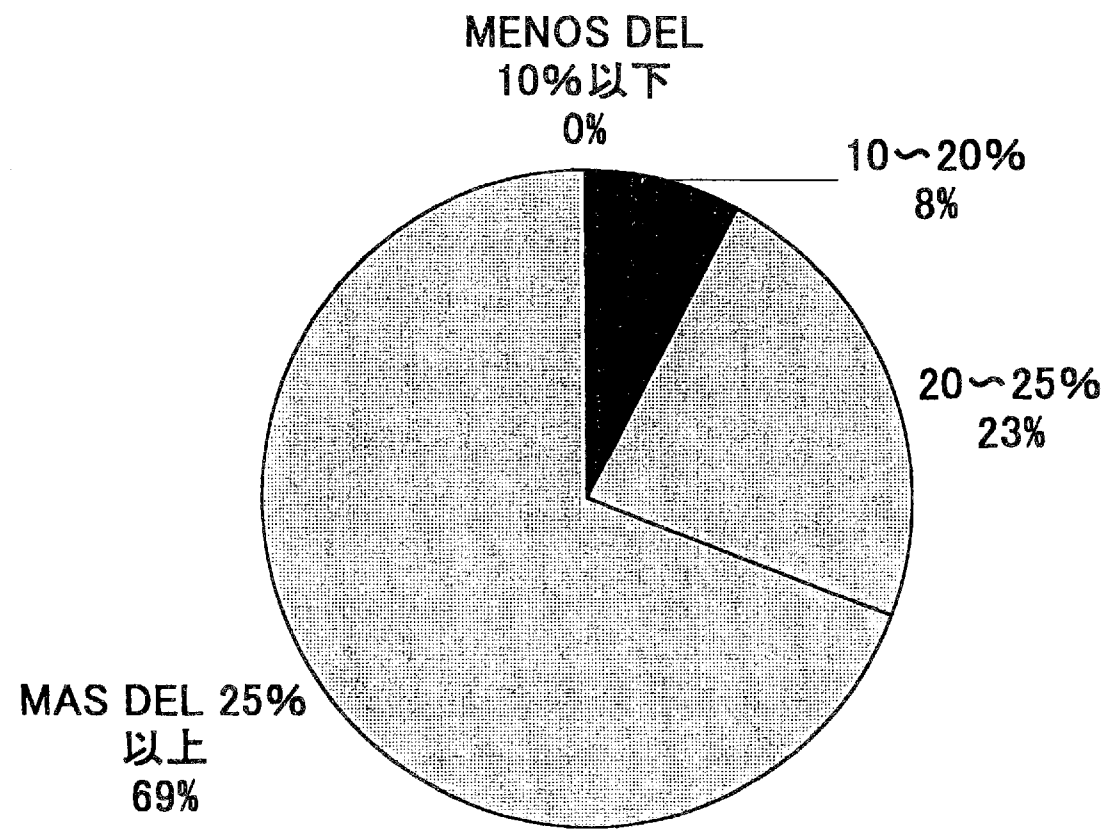

GRASA CORPORAL(F) 体脂肪率女性(n=44)

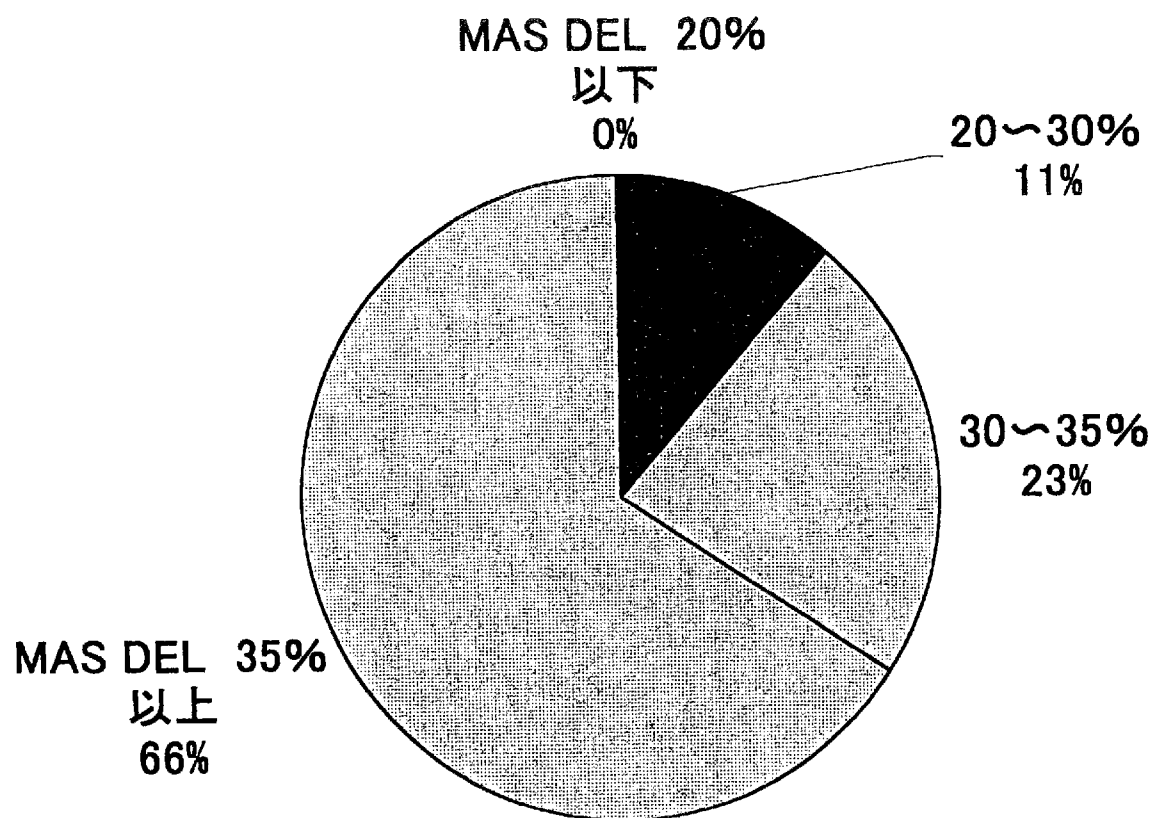

RESULTADO DE INVESTIGACION SOBRE LOS EQUIPOS


| No. | INSTITUCIONES MEDICOS | NOMBRE DE EQUIPO | MARCA | LUGAR DE INSTALACION | TIEMPO DE | TIPO DE SUMINISTRO | FUNCIONAMIENTO | MANTENIMIENTO | OBSERVACIONES |
|-----|-----------------------|--------------------|---------|----------------------|-----------|--------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | C.S. 10 de Octubre | Aspirador portátil | | Sala de Parto | 8 años | PROISS | C | E | Hace 1 año solicitó al DMS para arregrar este equipo pero hasta el momento |
| 2 | C.S. 10 de Octubre | Silla Dental | GYNATUS | Consultorio Dental | 8 años | PROISS | C | E | Hace 1 año solicitó al DMS para arregrar este equipo pero hasta el momento |
| 3 | C.S. San Antonio | Auto clave | | Sala de Parto | 8 años | PROISS | C | E | |
| 4 | C.S. Norte | Aspirador portátil | THOMAS | Sala de Parto | 8 años | PROISS | B | D | |
| 5 | C.S. Norte | Silla Dental | | Consultorio Dental | 8 años | PROISS | C | E | |
| 6 | C.S. Preventiva Sur | Silla Dental | ATLAS | Consultorio Dental | 8 años | PROISS | C | E | Desde la fecha Marzo de 2000 mismo condición |
| 7 | C.S. Preventiva Sur | Estilizador secado | MEMMERT | | 8 años | PROISS | C | E | |

Funcionamiento


- A Funciona 100%, estado bién
- B Funciona 80%, se puede utilizarlo aunque hay pequeño problema
- C No funciona
- D Funciona pero no utiliza
- E Imposible de arregrar, Objeto de bajas

Mantenimiento


- A Realiza el mantenimiento preventivo antes / después de uso
- B Realiza el mantenimiento preventivo 1 vez por semana
- C Realiza el mantenimiento preventivo 1 vez por mes
- D Realiza cuando hay falla del equipo (Por el base de solicitud)
- E No realiza nada

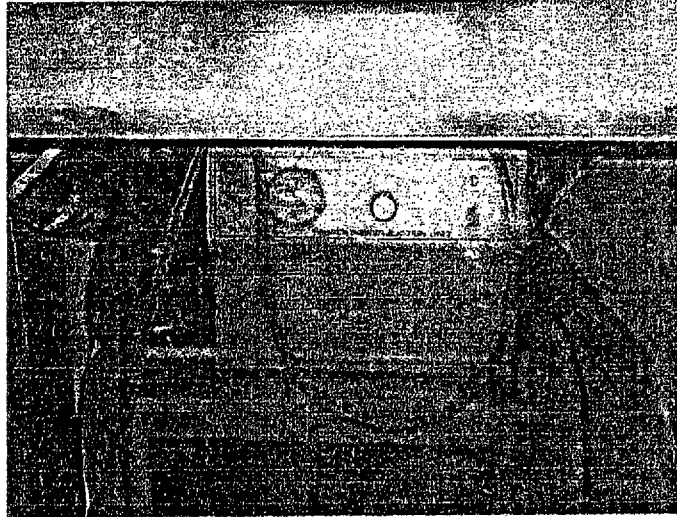

1. Aspirador Portátil, C.S. 10 de Octubre

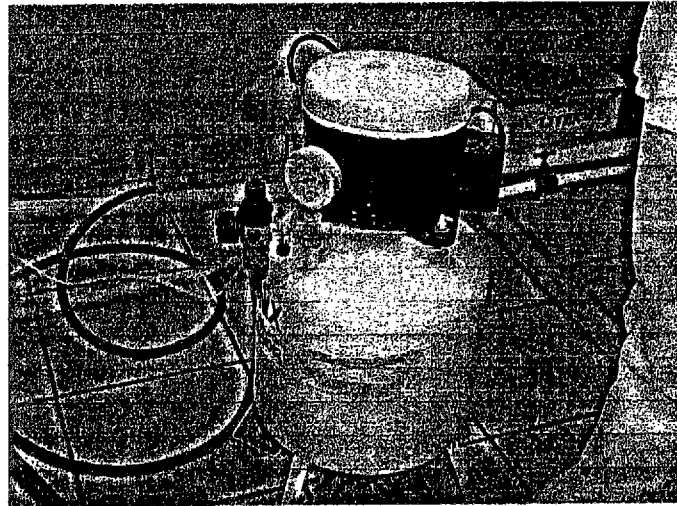


2. Silla Dental, C.S. 10 de Octubre

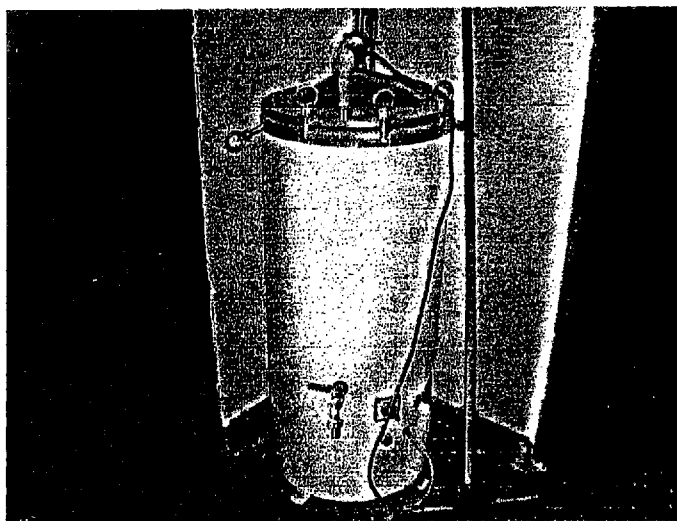

3. Auto clave, C.S. San Antonio




4. Aspirador Portátil, C.S. Norte

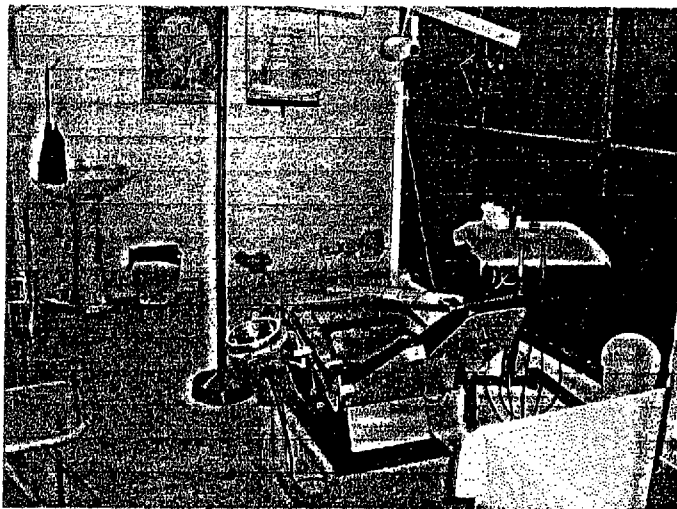

5. Silla Dental, C.S. Norte



6. Silla Dental, C.S. Preventiva Sur

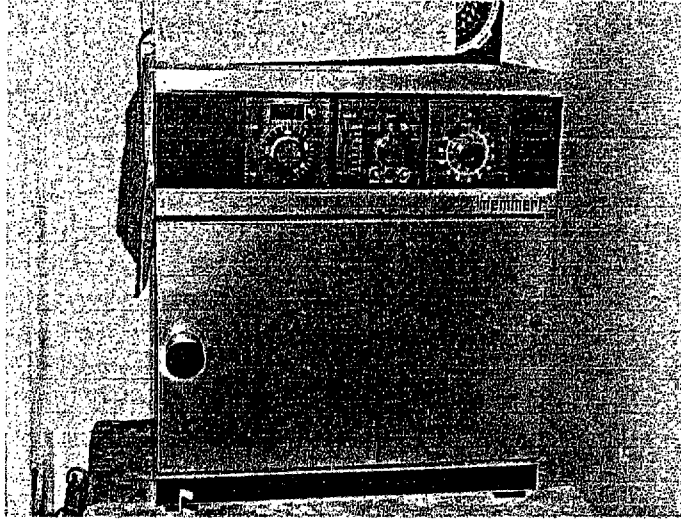

7. Esterilizador secado, C.S. Preventiva Sur

R.R.H.H. sobre servicio de mantenimiento de 5 hospitales

| No . | INSTITUCIONES MEDICOS | Número de Ingeniero | Número de Técnico para electromedicina | Número de Técnico para servicios |
|------|---------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Hospital Japonés | No hay | 3 técnicos | 8 técnicos |
| 2 | Hospital San Juan de Dios | No hay | 2 técnicos | 4 técnicos |
| 3 | Hospital Maternidad | 1 Ingeniero | No hay | 3 técnicos |
| 4 | Hospital de Niño | No hay | 2 técnicos | 2 técnicos |
| 5 | Hospital Oncológico | 1 Ingeniero | 2 técnicos | |

RESULTADO DE INVESTIGACION SOBRE LOS EQUIPOS


| No. | INSTITUCIONES MEDICOS | NOMBRE DE EQUIPO | MARCA | LUGAR DE INSTALACION | TIEMPO DE | TIPO DE SUMINISTRO | FUNCIONAMIENTO | MANTENIMIENTO | OBSERVACIONES |
|-----|---------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------|--------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | C.S. Norte | Equipo de Rayos X para Dental | GNATUS | Consultorio Dental | 8 años | PROISS | B | E | No puede usar por falta de suministrar las películas y líquidos reverados. |
| 2 | Hospital San Juan de Dios | Espectrofotómetro | BECKMAN | Laboratorio | 6 años | | C | E | No puede usar por falta de suministrar los reactivos. |
| 3 | Hospital Maternidad | Ecografo | SHIMADZU | Consultorio Gineecologo | | | B | D | No puede usar impresora por falta de suministrar los papeles exclusivos. |
| 4 | Hospital Japonés | Calciometro | JOOKOO | Laboratorio | 15 años | JICA | C | E | No puede usar por falta de suministrar los reactivos. |
| 5 | Hospital San Juan de Dios | Coaglurometro | ORGANON TECNICA | Laboratorio | 5 años | JICA | C | E | Reactivos exclusivos son muy costoso. |
| 6 | C.S. Mineros | Equipo de Rayos X para Dental | GNATUS | Consultorio Dental | | | C | D | Hace 6 meses no puede usar por falta de suministrar las películas. |

Funcionamiento

- A Funciona 100%, estado bién
- B Funciona 80%, se puede utilizarlo aunque hay pequeño problema
- C No funciona
- D Funciona pero no utiliza
- E Imposible de arregrar, Objeto de bajas

Mantenimiento

- A Realiza el mantenimiento preventivo antes / después de uso
- B Realiza el mantenimiento preventivo 1 vez por semana
- C Realiza el mantenimiento preventivo 1 vez por mes
- D Realiza cuando hay falla del equipo (Por el base de solicitud)
- E No realiza nada

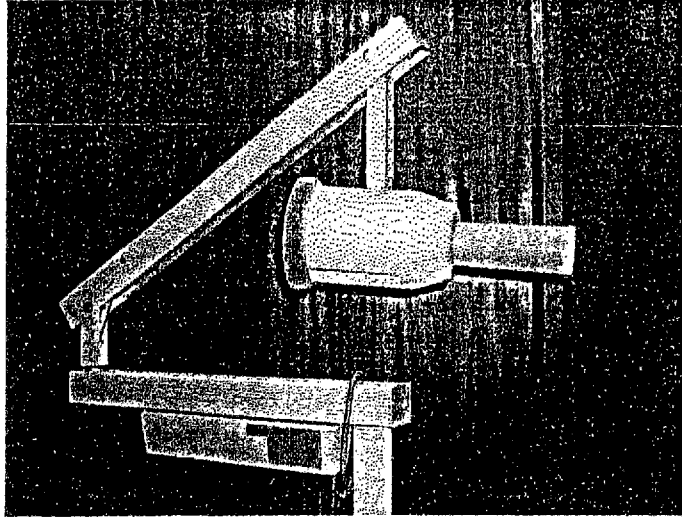

1. Equipo de Rayos X para Dental, C.S. Norte




2. Espectrofotómetro, Hospital San Juan de Dios




3. Ecografo, Hospital Maternidad




4. Calciometro, Hospital Japonés

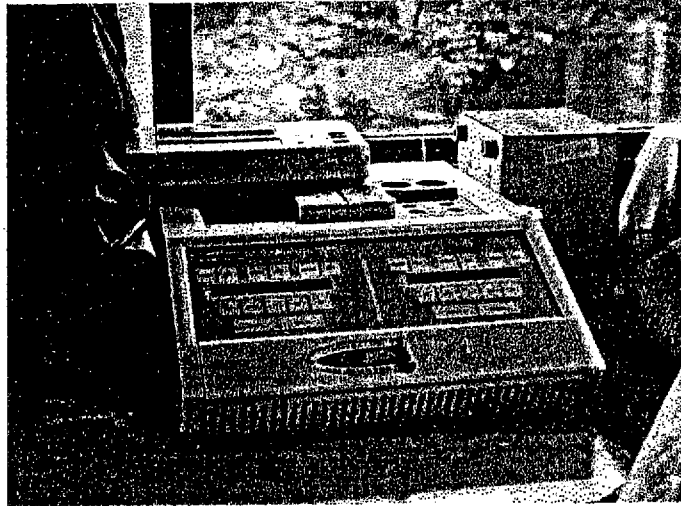

5. Coagulometro, Hospital San Juan de Dios

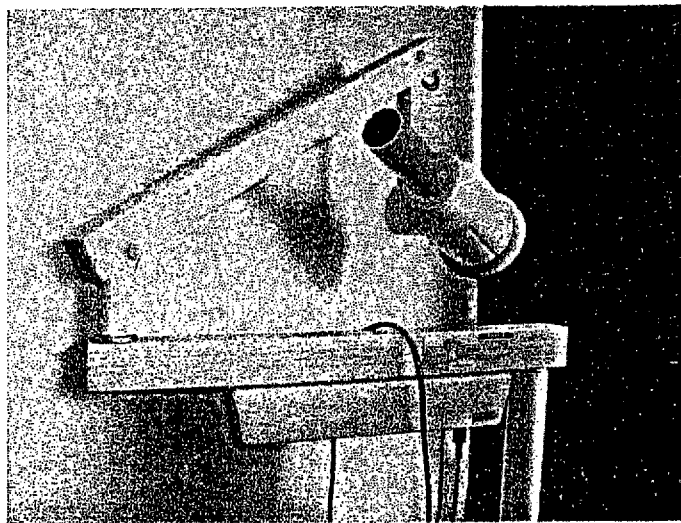

6. Equipo de Rayos X para Dental, C.S. Mineros

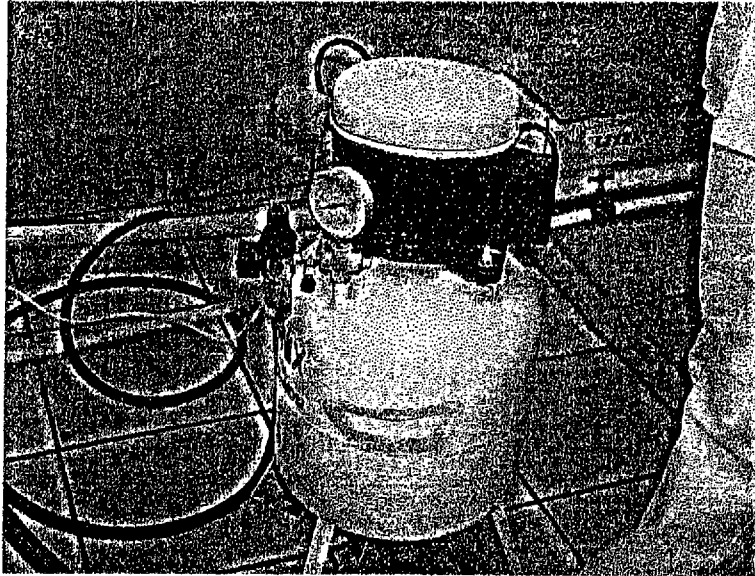

**1. Compresor para la pieza de mano de turbina, C.S. 10 de Octubre
Hay mucho riesgo de explotación**



**2. 3 gasometros misma marca (IL) existen en el Hospital San Juan de Dios.
Solamente 1 de ellos está funcionando, y esta fabrica ya no hay**

RESULTADO DE INVESTIGACION SOBRE LOS EQUIPOS

Centro de Salud, 10 de Octubre (Dis. II)

| | | | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| ITEM | : 01 | Fecha | : 2001/03/28 |
| Nombre de equipo | : Camara de ecografo | | |
| Marca | : ALOKA | | |
| Modelo | : SSD-500 | | |
| N. de Serie | : | | |
| Instalación | : (Consultorio de Ginecología) | | |
| Medio ambiente | : Temp. : 30 °C, Humd. : 70 %, Voltage : AC 220V, 50Hz, Aire acondicionado : SI o NO | | |
| Tiempo de uso | : años (Vida útil : 6 años) | | |
| Tipo de suministro | : 1999 por Proyecto de JICA, Suministrado en Japón | | |
| Funcionamiento | : No está instalado todavía por falta de preparar medio ambiente de instalación del equipo. | | |
| Mantenimiento | : No realice nada. | | |
| Observación | : | | |

Exterior del equipo

